



Преобразователи температуры СТ  
модификация CTR (CTU)

Руководство по эксплуатации  
КФГЮ.406402.000-01РЭ



Сертификат об утверждении типа средств измерений № 18714 от 30.04.2025,  
срок действия до 30.04.2030 Госреестр СИ РБ № 11956-25

Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011: ЕАЭС RU С-VY.НА65.В.01078/21  
от 05.07.2021, срок действия до 04.07.2026

Настоящий документ является руководством по эксплуатации преобразователей температуры СТ модификации CTR (CTU) с оснащением KZ или без монтажной головки (далее термопреобразователи) и содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации данных термопреобразователей.

## 1 Описание и работа

### 1.1 Назначение изделия

1.1.1 Термопреобразователи предназначены для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих сред, не агрессивных к материалу защитного корпуса термочувствительных элементов.

1.1.2 Термопреобразователи относятся к оборудованию, эксплуатируемому в стационарных условиях производственных помещений, вне жилых домов.

1.1.3 Термопреобразователи могут выполняться во взрывобезопасном исполнении с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» и маркировкой – Ga/Gb Ex ia IIC «T6...T1» X, Ex ia IIIC «T85 °C... T450 °C» Da X, предназначенном для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с документами, регламентирующими применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1.1.4 Термопреобразователи с исполнением монтажной головки (далее исполнение) ALZ/Exd могут выполняться во взрывобезопасном исполнении с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d» и маркировкой – Ga/Gb Ex d IIB+H<sub>2</sub> «T6...T1» X или 1Ex d IIB+H<sub>2</sub> «T6...T1» Gb X, во взрывобезопасном исполнении с видом взрывозащиты «пыленепроницаемая оболочка tb» и маркировкой – Ex tb IIIC «T85 °C...T450 °C» Da/Db X или Ex tb IIIC «T85 °C...T450 °C» Db X, предназначенном для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с документами, регламентирующими применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1.1.6 При заказе термопреобразователей должно быть указано его условное обозначение.

Условное обозначение термопреобразователей приведено в приложении А.

### 1.2 Основные технические характеристики

1.2.1 Диапазоны измерений, допускаемые отклонения от НСХ термопреобразователей с колодкой зажимной KZ, монтажной головкой PD, PM, ZG или без монтажной головки приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Модификация термопреобразователя                                                                                                                                      | Оснащение, исполнение     | НСХ     | Номинальное значение сопротивления при 0 °С, Ом | Температурный коэффициент сопротивления, α, °С <sup>-1</sup> | Класс допуска и пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, Δ <sub>тс</sub> , °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Диапазон измерений*, °С                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CTR                                                                                                                                                                   | KZ, без монтажной головки | Pt 100  | 100                                             | 0,00385                                                      | А – ±(0,15 + 0,002· t ) для диапазона измерений: от -70 °С до +450 °С – проволочный ЧЭ (D); от -30 °С до +300 °С – пленочный ЧЭ (М);<br>В – ±(0,3 + 0,005· t ) для диапазона измерений: от -70 °С до +600 °С – проволочный ЧЭ (D); от -50 °С до +500 °С – пленочный ЧЭ (М);<br>С – ±(0,6 + 0,01· t ) для диапазона измерений: от -70 °С до +600 °С – проволочный ЧЭ (D); от -50 °С до +600 °С – пленочный ЧЭ (М) | от -70 до +600                                              |
|                                                                                                                                                                       |                           | Pt 500  | 500                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|                                                                                                                                                                       |                           | Pt 1000 | 1000                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|                                                                                                                                                                       |                           | 50 М    | 50                                              | 0,00428                                                      | А – ±(0,15 + 0,002· t ) для диапазона измерений от -50 °С до +120 °С;<br>В – ±(0,3 + 0,005· t ) для диапазона измерений от -50 °С до +200 °С<br>С – ±(0,6 + 0,01· t ) для диапазона измерений от -70 °С до +200 °С                                                                                                                                                                                               | от -70 до +200                                              |
|                                                                                                                                                                       |                           | 100 Н   | 100                                             | 0,00617                                                      | С – ±(0,6 + 0,01· t )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | от -60 до + 180                                             |
| CTR                                                                                                                                                                   | монтажная головка PD, PM  | Pt 100  | 100                                             | 0,00385                                                      | В – ±(0,3 + 0,005· t )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | от -40 до +80<br>от -40 до +200<br>(специальное исполнение) |
|                                                                                                                                                                       |                           | Pt 500  | 500                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|                                                                                                                                                                       |                           | Pt 1000 | 1000                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|                                                                                                                                                                       | монтажная головка ZG с KZ | Pt 100  | 100                                             |                                                              | А – ±(0,15 + 0,002· t ) для диапазона измерений от -40 °С до +80 °С;<br>В – ±(0,3 + 0,005· t ) для диапазона измерений от -40 °С до +80 °С                                                                                                                                                                                                                                                                       | от -40 до +80                                               |
|                                                                                                                                                                       |                           | Pt 500  | 500                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|                                                                                                                                                                       |                           | Pt 1000 | 1000                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|                                                                                                                                                                       |                           |         |                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| * Указаны предельные значения диапазонов измерений, допускается изготовление термопреобразователей с диапазонами измерений, находящимися внутри указанных диапазонов. |                           |         |                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| Примечание –  t  – абсолютное значение измеряемой температуры, °С                                                                                                     |                           |         |                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |

1.2.2 Диапазоны измерений, допускаемые отклонения от НСХ термопреобразователей модификации СТU без монтажной головки или с колодкой зажимной KZ приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Модификация термопреобразователя                                                                                                                                      | Оснащение                 | НСХ  | Диапазон измерений*, °C | Класс допуска |                                                           | Пределы допускаемых отклонений от НСХ, Δ <sub>тп</sub> , °C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| СТУ                                                                                                                                                                   | KZ, без монтажной головки | J    | от -40 до +750          | 1             | от -40 °C до +375 °C вкл.<br>св. +375 °C до +750 °C вкл.  | ±1,5<br>±0,004· t                                           |
|                                                                                                                                                                       |                           |      |                         | 2             | от -40 °C до +333 °C вкл.<br>св. +333 °C до +750 °C вкл.  | ±2,5<br>±0,0075· t                                          |
|                                                                                                                                                                       |                           | L    | от -70 до +600          | 2             | от -40 °C до +300 °C вкл.<br>св. +300 °C до +600 °C вкл.  | ±2,5<br>±0,0075· t                                          |
|                                                                                                                                                                       |                           |      |                         | 3             | от -70 °C до +100 °C вкл.                                 | ±2,5                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                           | T    | от -70 до +350          | 1             | от -40 °C до +125 °C вкл.<br>св. +125 °C до +350 °C вкл.  | ±0,5<br>±0,004· t                                           |
|                                                                                                                                                                       |                           |      |                         | 2             | от -40 °C до + 133 °C вкл.<br>св. +133 °C до +350 °C вкл. | ±1,0<br>±0,0075· t                                          |
|                                                                                                                                                                       |                           |      |                         | 3             | от -70 °C до +40 °C вкл.                                  | ±1,0                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                           | K, N | от -70 до +1200         | 1             | от -40 °C до +375 °C вкл.<br>св. 375 °C до 1000 °C вкл.   | ±1,5<br>±0,004· t                                           |
|                                                                                                                                                                       |                           |      |                         | 2             | от -40 °C до +333 °C вкл.<br>св. +333 °C до +1200 °C вкл. | ±2,5<br>±0,0075· t                                          |
|                                                                                                                                                                       |                           |      |                         | 3             | от -70 °C до +40 °C вкл.                                  | ±2,5                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                           | S    | от 0 до +1200           | 1             | от 0 °C до +1100 °C вкл.                                  | ±1,0                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                           |      |                         | 2             | св. 0 °C до +600 °C вкл.<br>св. +600 °C до +1200 °C вкл.  | ±1,5<br>±0,0025· t                                          |
| * Указаны предельные значения диапазонов измерений, допускается изготовление термопреобразователей с диапазонами измерений, находящимися внутри указанных диапазонов. |                           |      |                         |               |                                                           |                                                             |
| Примечание –  t  – абсолютное значение измеряемой температуры, °C                                                                                                     |                           |      |                         |               |                                                           |                                                             |

1.2.3 Допуски термопреобразователей по сопротивлению при температуре  $t$  – по ГОСТ 6651.

1.2.4 Максимальный измерительный ток термопреобразователей – не более 1,0 мА.

1.2.5 Время термической реакции ( $\tau_x$ ) термопреобразователей соответствует требованиям таблицы 3.

Таблица 3

| Диаметр защитного корпуса, мм | Время термической реакции $\tau_{0,5}$ при 50 % полного изменения показаний термопреобразователя, с, не более |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $d \leq 3$                    | 10                                                                                                            |
| $3 < d \leq 5$                | 15                                                                                                            |
| $5 < d \leq 6$                | 20                                                                                                            |
| $6 < d \leq 8$                | 30                                                                                                            |

1.2.6 Термоэлектродвижущая сила (ТЭДС) на выводах термопреобразователей при максимальной температуре диапазона измерений и максимальном измерительном токе не приводит к выходу термопреобразователя из класса допуска при двух направлениях тока в измерительной цепи термопреобразователя.

1.2.7 Стабильность термопреобразователей – по ГОСТ 6651.

1.2.8 Сопротивление термопреобразователей при 0 °С остается в пределах допуска соответствующего класса после 10 циклов изменения температуры от верхнего до нижнего предела диапазона измерений.

1.2.9 Значения сопротивления термопреобразователей, измеренные в одной и той же температурной точке, соответствующей  $\frac{1}{2}$  диапазона измерений в условиях нагрева и охлаждения термопреобразователей от верхнего до нижнего предела диапазона измерений не более предела допуска соответствующего класса.

1.2.10 Показатель тепловой инерции ( $\tau_{0,5}$ ) термопреобразователей модификации СТU не более с диаметром защитного корпуса, d, мм:

- $d \leq 6$  – 20;
- $6 < d \leq 10$  – 25;
- $d > 10$  – 40.

1.2.11 Конструкция термопреобразователей модификации СТU обеспечивает стабильность термопреобразователей при воздействии температуры верхнего рабочего значения диапазона измерений в течение 2 ч. Изменения НСХ термопреобразователей после воздействия этой температуры не более 0,5 допускаемых отклонений, указанных в таблице 2.

1.2.12 Длина монтажной части термопреобразователей в зависимости от конструктивного исполнения:

- модификации СТР:
  - от 30 мм для диапазона измерений  $\leq 200$  °С;
  - от 200 мм для диапазона измерений  $\leq 600$  °С;
  - от 250 мм для диапазона измерений  $> 600$  °С.
- модификации СТU:
  - 20 мм для диапазона измерений  $\leq 200$  °С;
  - от 200 мм для диапазона измерений  $\leq 700$  °С;
  - от 250 мм для диапазона измерений  $> 700$  °С.

Диаметр защитного корпуса от 0,5 до 28 мм. Допуски для внешних диаметров защитного корпуса – от  $\pm 140$  мкм до  $\pm 0,3$  мм.

1.2.13 Длина погружаемой части термопреобразователей без монтажных приспособлений в зависимости от конструктивного исполнения:

- модификации СТР:
  - от 30 мм для диапазона измерений  $\leq 200$  °С;
  - от 200 мм для диапазона измерений  $\leq 600$  °С;
  - от 250 мм для диапазона измерений  $> 600$  °С.
- модификации СТU:
  - 20 мм для диапазона измерений  $\leq 200$  °С;
  - от 200 мм для диапазона измерений  $\leq 700$  °С;
  - от 250 мм для диапазона измерений  $> 700$  °С.

Длина погружаемой части термопреобразователей с монтажными элементами равна длине монтажной части термопреобразователей.

1.2.14 Минимальная глубина погружения термопреобразователей в зависимости от конструктивного исполнения при температуре 0 °С и наружной комнатной температуре:

- модификации СТР:
  - 30 мм для диапазона измерений  $\leq 200$  °С;
  - от 200 мм для диапазона измерений  $\leq 600$  °С;
  - от 250 мм для диапазона измерений  $> 600$  °С.

- модификации СТU:
- 20 мм для диапазона измерений  $\leq 200$  °С;
- от 200 мм для диапазона измерений  $\leq 700$  °С;
- от 250 мм для диапазона измерений  $> 700$  °С.

1.2.15 Степень защиты термопреобразователей от воздействия пыли, посторонних тел и воды по ГОСТ 14254 в зависимости от вида защитного корпуса и исполнения монтажной головки:

- IP00 для конструктивного исполнения W, U01;
- для конструктивных исполнений BT, BT $\alpha$ , T, T $\alpha$ , TK, TK $\alpha$ , E1, E2, GE1, B: IP00 – без монтажного соединения;
- IP20 – с разъемом для термопары или термосопротивления (розетка/или вилка);
- IP54 – в месте соединения ТС или ТП с кабелем, или разъемом, кроме конструктивных исполнений BT, BT $\alpha$  – IP50;
- IP54 для исполнения AL50 (MA);
- IP65, IP66, IP66/IP67, IP67 для исполнений AL70 (NA), AL70-2 (DANAW), AL85 (DA), ALZ (DAO), PZ (SEG), PD, PM, A ZG\*.

\* определяется степенью защиты ввода кабельного по заказу.

1.2.16 По способу защиты от поражения электрическим током термопреобразователи соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

1.2.17 По устойчивости к механическим воздействиям термопреобразователи являются виброустойчивыми и относятся к группе исполнения N2 по ГОСТ 12997.

1.2.18 Термопреобразователи по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха относятся к группе С2 ГОСТ 12997, но для работы при значениях температур в зависимости от исполнения и оснащения монтажной головки (далее оснащение):

- термопреобразователи с оснащением KZ – от минус 40 °С до плюс 150 °С;
- термопреобразователи с монтажной головкой ZG с оснащением KZ – от минус 40 °С до плюс 80 °С;
- термопреобразователи с оснащением KZ или без монтажной головки специального исполнения Ex – от минус 40 °С до плюс 75 °С;
- термопреобразователи исполнения ALZ/Exd (DAO/Exd) – от минус 50 °С до плюс 60 °С.

1.2.19 Термопреобразователи согласно ГОСТ 27.003 относятся к изделиям конкретного назначения, вида 1, непрерывного применения, восстанавливаемые.

1.2.20 Искробезопасные электрические параметры термопреобразователей модификаций СТ $\alpha$ , СТU с оснащением колодкой зажимной KZ или без монтажной головки должны соответствовать требованиям таблицы 4.

Таблица 4

| Наименование параметра                              | Значение параметра |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Входные искробезопасные электрические параметры     |                    |
| – максимальное входное напряжение $U_i$ , В         | 30                 |
| – максимальный входной ток $I_i$ , мА               | 10                 |
| – максимальная внутренняя индуктивность $L_i$ , мГн | пренебрежимо мала  |
| – максимальная внутренняя емкость $C_i$ , нФ        | 1,0                |
| – максимальная входная мощность $P_i$ , Вт          | 0,1                |

1.2.21 Параметры термопреобразователей с исполнением монтажной головки ALZ/Exd во взрывобезопасном исполнении с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d» и маркировкой – Ga/Gb Ex d IIВ+H<sub>2</sub> «Т6...Т1» X или Ex d IIВ+H<sub>2</sub> «Т6...Т1» Gb X должны быть не хуже установленных в ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1.

1.2.22 Термопреобразователи с исполнением монтажной головки ALZ/Exd во взрывобезопасном исполнении с видом взрывозащиты «пыленепроницаемая оболочка tb» и маркировкой – Ex tb IIIС «Т85 °С...Т450 °С» Da/Db X или Ex tb IIIС «Т85 °С...Т450 °С» Db X соответствуют требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-31.

1.2.23 Электрическая изоляция между цепями ТС (ТП) термопреобразователей и корпусом, при температуре окружающего (25±10) °С, относительной влажности от 30 % до 80 %, и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа выдерживает в течение 1 мин действие испытательного переменного напряжения 250 В синусоидальной формы частотой 50 Гц, исполнений Ex – 500 В синусоидальной формы частотой 50 Гц.

1.2.24 Электрическое сопротивление изоляции между цепью ТС (ТП) и корпусом термопреобразователей при нормальных условиях (от 15 °С до 35 °С) не менее 100 МОм.

1.2.25 Показатели надежности термопреобразователей соответствуют следующим значениям:

- 1) средняя наработка на отказ, не менее – 100000 ч;
- 2) Средний срок службы не менее:
  - 1 года при значениях температуры эксплуатации  $\geq 1000$  °С, соответствующей значениям допустимой температуры длительного применения;
  - 5 лет при температурах эксплуатации применения  $\leq 1000$  °С, эксплуатации при полном погружении погружаемой части термопреобразователя в подвижную среду и/или эксплуатации при скорости потока более 80 % от максимальной расчётной;
  - 10 лет при температурах эксплуатации  $\leq 1000$  °С и погружении погружаемой части термопреобразователя не более 2/3 длины погружаемой части термопреобразователя и рабочие скорости потока не превышают 80 % от максимальной расчетной скорости;
  - не нормируется, в соответствии с естественно ограниченным сроком службы материалов термопреобразователей в химически агрессивных средах.

1.2.25.1 Средний срок службы термопреобразователей, работающих в агрессивных средах, в соответствии с естественно ограниченным сроком службы материалов термопреобразователей согласно действующих ТНПА.

## 1.2.25.2 Отказом термопреобразователей считают:

- несоответствие требованиям, указанным 2.1;
- развитие чрезмерных деформаций от статических или динамических нагрузок;
- образование и развитие трещин.

1.2.26 Габаритные размеры: согласно рисунков А.1 – А.17 КФГЮ.406402.000-01РЭ.

1.2.27 Масса термопреобразователей не более 20 кг.

1.2.28 Материал монтажной головки – алюминий, нержавеющая сталь или полимеры.

1.2.28.1 Детали термопреобразователей, соприкасающиеся с измеряемой средой, изготовлены:

- для пищевой промышленности из стали 08X18H10, AISI 304, 1.4301, 316Ti, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4841 по действующим ТНПА;
- остальные отрасли промышленности из стали AISI304, 08X18H10T, 12X18H10T по ГОСТ 5949 или аналогичных по действующим ТНПА, а для особо агрессивных сред – из титана и титановых сплавов по ГОСТ 19807, тантала или сплавов 03X16H15M3, 06XH28МДТ по ГОСТ 5632 или аналогичных по действующим ТНПА, корунда или аналогичных по действующим ТНПА.

## 1.3 Комплектность

1.3.1 Комплектность поставки термопреобразователя соответствует указанной в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование                                                                                                                             | Кол-во  | Примечание             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Преобразователь температуры СТ                                                                                                           | 1 шт.   | По спецификации заказа |
| Преобразователь температуры СТ. Паспорт                                                                                                  | 1 экз.  |                        |
| Преобразователи температуры СТ. Руководство по эксплуатации                                                                              | 1 экз.* |                        |
| МРБ МП.2516–2015 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Преобразователи температуры СТ. Методика поверки»          | 1 экз.* | –                      |
| Упаковка                                                                                                                                 | 1 шт.   | –                      |
| * Допускается прилагать 1 экз. на бумажном носителе и/или в электронном виде, на партию термопреобразователей поставляемых в один адрес. |         |                        |

## 1.4 Устройство и работа

1.4.1 Конструктивно термопреобразователь (рисунки А.1 – А.9) состоит из термометрической вставки (защитный чехол и термопреобразователь сопротивления с НСХ по ГОСТ 6651: медные ТС 50 М с  $\alpha=0,00428\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ , платиновые ТС (Pt 100, Pt 500, Pt 1000) с  $\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ , никелевые ТС (100 Н) с  $\alpha=0,00617\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$  (далее ТС), защитный чехол и преобразователь термоэлектрический по ГОСТ 6616 с номинальной статической характеристикой (далее НСХ) по СТБ ГОСТ Р 8.585: J, K, S, T, N, L (далее ТП), которая помещена в защитный корпус.

Защитный корпус с помощью зажимного штуцера соединяется с монтажной головкой (при наличии). Термопреобразователь может иметь один, два или по заказу ТС (ТП). Монтажная головка изготовлена из алюминиевого сплава с откидной крышкой, из нержавеющей стали или из полимеров, имеет сальниковый кабельный ввод и обеспечивает степень защиты IP65, IP66/IP67, IP66, IP67 в зависимости от степени защиты кабельного ввода. Степень защиты конструктивного исполнения W – IP00.

В конструктивном исполнении W или внутри монтажной головки расположена колодка зажимная KZ.

Для различных условий монтажа (монтажные, посадочные размеры), различных характеристик сред измерения (агрессивность, температура) защитный корпус термопреобразователя изготавливается различных модификаций, которые отличаются длиной монтажной части, с вынесением монтажной головки, способом крепления. Тип защитного корпуса выбирается при заказе.

## 1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 На табличках, прикрепленных к термопреобразователю или на прикрепленную к нему бирку, нанесены следующие знаки и надписи:

- наименование и условное обозначение термопреобразователя\*;
- товарный знак изготовителя\*;
- обозначение ТУ\*;
- номер сертификата соответствия (для взрывобезопасного исполнения)\*;
- маркировка взрывозащиты (для взрывобезопасного исполнения)\*;
- маркировка специального исполнения Exd «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ»\*;
- диапазон измерений,  $^{\circ}\text{C}$ \*;
- диапазон выходного сигнала;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя\*;
- год выпуска\*;
- наименование и адрес изготовителя;
- знак утверждения типа средств измерений\*;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза\*;
- изображение специального знака взрывобезопасности (для взрывобезопасного исполнения)\*;
- степень защиты по ГОСТ 14254.

На потребительскую тару:

- наименование и условное обозначение термопреобразователя;
- заводской порядковый номер;
- год упаковки;
- наименование и адрес изготовителя;
- штамп ОТК и подпись ответственного за упаковку.

\* Обязательные надписи, остальные надписи и знаки допускается указывать только в эксплуатационной документации на термопреобразователи.

Допускается дополнять маркировку другими знаками и надписями.

## 1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковка термопреобразователей обеспечивает сохранность термопреобразователей при хранении и транспортировании.

1.6.2 Упаковку производят в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от 15 °С до 40 °С при уровне относительной влажности от 10 % до 95 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.6.3 Термопреобразователи в чехле из полимерной пленки (LDPE) помещены в картонный (РАР) ящик. Свободное пространство между термопреобразователем и ящиком заполнено амортизационным материалом – пленкой воздушно-пузырьковой (LDPE) или пеной полиуретановой (О).

Допускается групповая упаковка термопреобразователей.

Эксплуатационная документация вложена в чехол из полимерной пленки (LDPE).

1.6.4 Средства консервации соответствуют варианту защиты ВЗ-0 ГОСТ 9.014.

1.6.5 Термопреобразователи в картонном ящике уложены в транспортную тару – ящики из гофрированного картона (РАР) ГОСТ 9142. Свободное пространство между термопреобразователями и ящиком заполнено амортизационным материалом. При необходимости дополнительно применяется упаковочный материал – пленка воздушно-пузырьковая (LDPE) или пена полиуретановая (О).

1.6.6 Товаросопроводительная документация вложена в чехол из полимерной плёнки (LDPE).

## 2 Использование по назначению

### 2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Сопротивление изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры термометра при нормальных условиях не менее 2 МОм.

**2.1.2 ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОРПУС.**

**2.1.3 ВНИМАНИЕ! УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, ЗАМЕНА, ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ С ОБЪЕКТА ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

**2.1.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация термопреобразователей при температурах превышающих диапазон измерений.**

2.1.5 При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании термопреобразователя необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте эксплуатации.

2.1.6 Специальные условия применения (если в маркировке взрывозащиты указан знак «X»)

Знак X, стоящий после маркировки взрывозащиты, указывает, что при эксплуатации термопреобразователей, необходимо соблюдать следующие специальные условия применения:

2.1.6.1 Знак X, стоящий после маркировки взрывозащиты, указывает, что при эксплуатации термопреобразователей, необходимо соблюдать следующие специальные условия применения:

2.1.6.2 Электропитание термопреобразователей должно осуществляться от сертифицированных в установленном порядке блоков искробезопасного питания или от обычных блоков питания через барьеры искрозащиты, обеспечивающие необходимые параметры искробезопасной цепи по ГОСТ 30852.10.

Электрические параметры термопреобразователей с учетом параметров соединительного кабеля должны соответствовать электрическим параметрам, указанным на барьере искрозащиты.

2.1.6.3 Параметры взрывонепроницаемых соединений термопреобразователей с исполнением монтажной ALZ/Exd отличаются от установленных по ГОСТ IEC 60079-1 и приведены на рисунке 1 и таблице 6.

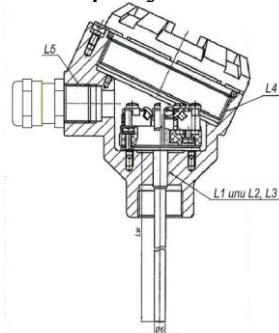


Таблица 6

| Обозначение | Длина L, мм | Диаметр D max, мм         | Диаметр d min, мм                  | Зазор D-d, мм | Требования ГОСТ IEC 60079-1 |
|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| L1          | 16,5        | $\varnothing 8^{+0,058}$  | $\varnothing 8^{+0,040}_{-0,076}$  | 0,134         | min. 12,5                   |
| L2          | 16,5        | $\varnothing 10^{+0,058}$ | $\varnothing 10^{+0,040}_{-0,076}$ | 0,134         | min. 12,5                   |
| L3          | 16,5        | $\varnothing 9^{+0,058}$  | $\varnothing 9^{+0,040}_{-0,076}$  | 0,134         | min. 12,5                   |
| L4          | 12/8        | M72x1,5-6H                | M72x1,5-6g                         |               | min. 8/min. 5               |
| L5          | 12,5/8      | M20x1,5-6H                | M20x1,5-6g                         |               | min. 8/min. 5               |

Рисунок 1 – Схема взрывонепроницаемых соединений

2.1.6.3 Максимальная температура поверхности/температурный класс термопреобразователей с оснащением монтажной головки колодкой зажимной KZ или без монтажной головки, с исполнением монтажной головки ALZ/Exd устанавливается в зависимости от температуры процесса (контролируемой среды), способа монтажа в соответствии с технической документацией изготовителя и таблицей 7.

Таблица 7

| Температурный класс<br>(для газа) | Максимальная температура<br>поверхности, °C<br>(для пыли) | Максимальная температура контролируемой<br>среды, °C |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| T6                                | 85                                                        | 80                                                   |
| T5                                | 100                                                       | 95                                                   |
| T4                                | 135                                                       | 130                                                  |
| T3                                | 200                                                       | 195                                                  |
| T2                                | 300                                                       | 290                                                  |
| T1                                | 450                                                       | 440                                                  |

2.1.6.4 Ввод кабелей в оболочки термопреобразователей Exd-исполнения должен осуществляться через кабельные вводы, имеющие сертификат соответствия ТР ТС на электрооборудование с видом взрывозащиты “d” для взрывоопасной газовой смеси категории ПС; неиспользуемое отверстие должно быть закрыто с помощью взрывонепроницаемой заглушки, входящей в комплект термопреобразователей. Кабельный ввод и заглушка должны устанавливаться с использованием специального фиксирующего состава, предназначенного для предотвращения самопроизвольного ослабления резьбовых соединений.

Исходя из максимальной температуры контролируемой среды, согласно таблице 6 следует определить допустимый температурный класс преобразователя T \*\* для газов и максимальную температуру поверхности T \* для пыли.

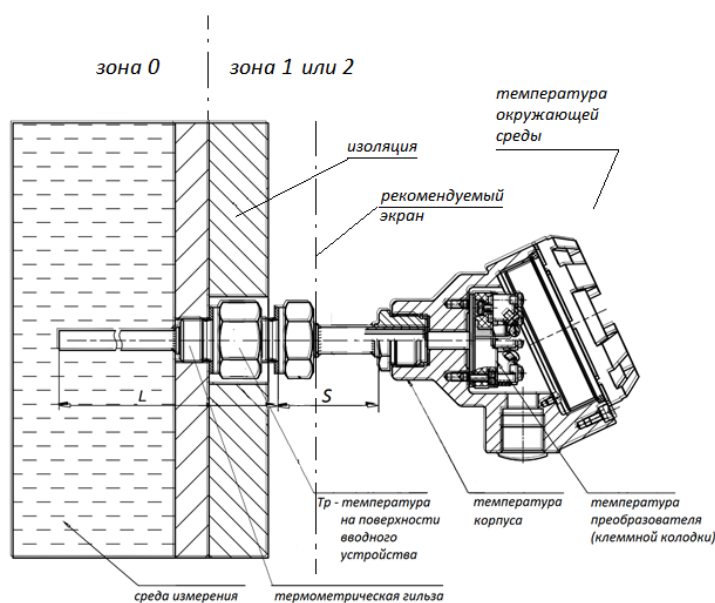


Рисунок 2 – Определение температуры первичного преобразователя или термопреобразователя

В случае изменения значения максимальной температуры среды необходимо заново определить допустимый температурный класс для газов или максимальную температуру поверхности термопреобразователя для горючей пыли. Допустимая рабочая температура кабельного ввода не должна быть меньше чем ожидаемая температура, которой может достичь поверхность монтажной головки ALZ/Exd (DAO/Exd), как указано в 2.1.7.3.

В случае измерений невзрывоопасных сред максимальная контролируемая температура среды может быть выше, чем указанная в таблице 7 при условии, что тепло среды не сможет нагреть никакую поверхность термопреобразователя, находящегося во взрывоопасной зоне выше допустимой температуры согласно таблицы 7. В этом случае должна быть измерена максимальная температура элементов термопреобразователя (как правило -  $T_p$ ) в условиях установки на объекте при максимальных температурах контролируемой и окружающей сред. Определенное таким образом значение температуры  $T_p$  не должно превышать предела, указанного в столбце 3 таблицы 7.

2.1.6.5 Ввод кабелей в оболочки термопреобразователей Exd-исполнения должен осуществляться через кабельные вводы, имеющие сертификат соответствия ТР ТС на электрооборудование с видом взрывозащиты “d” для взрывоопасной газовой смеси категории ПС; неиспользуемое отверстие должно быть закрыто с помощью взрывонепроницаемой заглушки, входящей в комплект термопреобразователей.

Кабельный ввод и заглушка должны устанавливаться с использованием специального фиксирующего состава, предназначенного для предотвращения сампроизвольного ослабления резьбовых соединений.

## 2.2 Подготовка изделия к использованию

### 2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

2.2.1.1 По степени защиты человека от поражения электрическим током термопреобразователи относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

2.2.1.2 Устранение дефектов, замена, присоединение и отсоединение термопреобразователя должны проводиться при отключении напряжения питания с объекта эксплуатации.

2.2.1.3 При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании термопреобразователя необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с требованиями охраны труда, установленными на объекте эксплуатации.

### 2.2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.2.1 Схемы электрических присоединений приведены на рисунках 3, 4.

Допускается электрическое присоединение термопреобразователей по схеме заказчика.

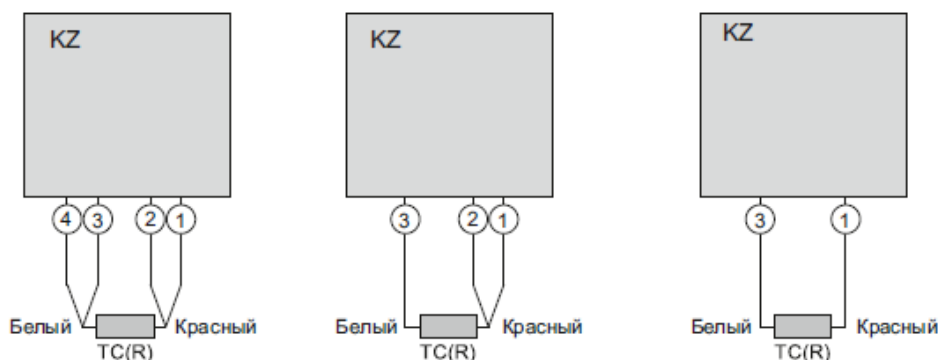


Рисунок 3 – Схема внешних электрических соединений термопреобразователей модификации СТР с оснащением монтажной головки KZ

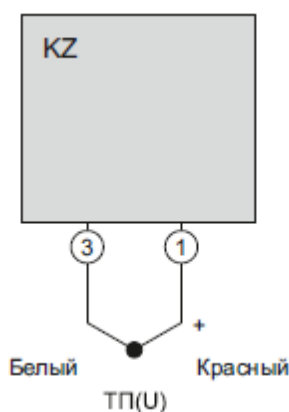


Рисунок 4 – Схема внешних электрических соединений термопреобразователей модификации СТU с оснащением монтажной головки KZ

2.2.2.2 Линия, соединяющая термопреобразователь с совместно работающими приборами и источником питания, должна вестись медными экранированными проводами с сечением от 0,5 до 1,5 мм<sup>2</sup> равной длины одинакового сечения, в соответствии с требованиями ПУЭ.

2.2.2.3 Для обеспечения герметичности конструкции монтажной головки, плотно закрутить гайку сальникового ввода, закрыть крышку и с усилием закрутить винт.

При необходимости опломбировать монтажную головку термопреобразователя, используя предназначенные пазы в крышке и в корпусе головки.

2.2.2.4 Термопреобразователи могут монтироваться в произвольной рабочей позиции.

2.2.2.5 Перед монтажом термопреобразователя необходимо проверить целостность измерительной цепи, сопротивление изоляции между измерительной цепью и корпусом должно соответствовать 1.2.30.

2.2.2.6 Монтаж производится в местах доступных для обслуживания (по возможности).

2.2.2.7 В трубопроводах термопреобразователи следует устанавливать так, чтобы он находился на оси трубопровода.

Конец погружаемой части термопреобразователей с платиновыми ТС должен быть на 50 – 70 мм ниже оси измеряемого потока, а с медными ТС — на 25 – 30 мм. При установке на колене трубопровода термопреобразователь должен быть направлен навстречу потоку и расположен в центре потока измеряемой среды.

2.2.2.8 Монтаж следует производить в местах, где поток рабочей среды измерения не нарушается открытием или закрытием близко расположенной запорной и регулирующей аппаратурой и т.п.

2.2.2.9 При измерениях температуры в трубопроводах с малой скоростью течения (особенно газовых) применять, в месте монтажа термопреобразователя, сужение трубопровода (увеличить скорость течения).

2.2.2.10 При измерении температуры сред более 400 °С необходимо устанавливать термопреобразователи вертикально, но с таким расчетом, чтобы температура монтажной головки не превышала допустимой.

2.2.2.11 Монтаж термопреобразователя должен выполняться с учетом уменьшения притока тепла к погружаемой части извне. Наружная часть термопреобразователя должна теплоизолироваться или экранироваться от нагрева.

2.2.2.12 При необходимости монтажа термопреобразователя горизонтально с данной погружаемой части свыше 500 мм должна быть предусмотрена дополнительная опора.

2.2.2.13 ВНИМАНИЕ!

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ОБОРУДОВАНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

2.2.2.14 Отказом термопреобразователя при работе может послужить обрыв или короткое замыкание измерительной цепи, превышение допускаемых измеряемых температур, изменение электрического сопротивления изоляции.

2.2.3 Использование изделия

2.2.3.1 Настройка и градуировка

2.2.3.1.1 Термопреобразователи отградуированы изготовителем на пределы измерений, соответствующие указанным в заказе на прибор.

2.2.3.1.2 Диапазон измерений термопреобразователей. Рекомендации

2.2.3.1.2.1 Максимальный диапазон измерений температур, который может быть измерен термопреобразователем, называется диапазоном измерений (см. 1.2.1, 1.2.2). Ширина диапазона измерений – это разница между верхней и нижней границами диапазона измерений.

2.2.3.1.2 Градуировка термопреобразователя

Термопреобразователь может быть отградуирован с помощью термометра сопротивления эталонного ЭТС-100 (градуировочный вход).

Значения градуировочных точек не обязательно должны быть равны верхней и нижней границам основного диапазона, но они не должны выходить за пределы диапазона. Ширина градуировочного диапазона должна быть не менее минимально допустимого установленного диапазона. Для обеспечения наименьших погрешностей градуировки рекомендуется, чтобы градуировочные точки были по возможности ближе к границам устанавливаемого диапазона.

3 Техническое обслуживание

3.1 В процессе технического обслуживания необходимо выполнить следующие работы:

- проверить сохранность пломб (при наличии);
- проверить состояние соединений электрических (проверка контактов, состояние уплотнений и сальников);
- проверить обрыв или повреждения изоляции соединительного кабеля;
- проверить отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыль и грязь на корпусе термопреобразователя.

3.2 В случае отсутствия сигнала в токовой петле или его неправильного значения, необходимо проверить линию, состояние контактов на клеммах, разъёмах и т. д.

Проверить правильность напряжения питания и сопротивления нагрузки.  
После обнаружения устраните обнаруженные неисправности.

3.3 Периодичность профилактических осмотров термопреобразователей устанавливается потребителем, но не реже 2 раза в год.

#### 3.4 Заменяемые элементы

3.4.1 Элементы термопреобразователя, которые в случае повреждения могут быть заменены - уплотнение крышки и сальник кабельного ввода.

Остальные части может заменить только изготовитель или лицо им уполномоченное.

3.5 Эксплуатация термопреобразователей с повреждением категорически запрещается.

### 4 Текущий ремонт

4.1 Организации, осуществляющие ТО и ремонт термопреобразователей марки «APLISENS»:

– изготовитель: СООО «АПЛИСЕНС»

Республика Беларусь, 210516, г. Витебск, ул. М. Горького, д.42А, каб.7  
тел./факс (0212) 36-36-98, (044) 552-30-30  
e-mail: [info@aplisens.by](mailto:info@aplisens.by); [www.aplisens.by](http://www.aplisens.by)

– официальный торгово-технический представитель СООО «АПЛИСЕНС» в Республике Беларусь:

ООО «Научно-производственный центр «Европрибор»  
Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. М. Горького, д.42А  
тел./факс (0212) 66-66-36, 66-66-26, 66-66-47, тел. (029) 366-49-92  
e-mail: [info@evropribor.by](mailto:info@evropribor.by); [www.evropribor.by](http://www.evropribor.by)

– официальный торгово-технический представитель СООО «АПЛИСЕНС» в Республике Казахстан:

ТОО «APLISENS Middle Asia» (АПЛИСЕНС Мидл Эйша)  
050000, Республика Казахстан, г. Алматы  
район Ауэзовский, проспект Райымбек, 348/4, оф. 800 БЦ АСПАРА  
тел./факс +7 727 225-48-68, +7 727 321-21-48, +7 701 884 40 04  
e-mail: [info@aplisens.kz](mailto:info@aplisens.kz); [www.aplisens.kz](http://www.aplisens.kz)

#### 4.2 ВНИМАНИЕ!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ РЕМОНТ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

#### 4.3 ВНИМАНИЕ!

НА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ИМЕЮЩИЙ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ ИЛИ ВНУТРЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, ТЕМПЕРАТУРНЫХ, ХИМИЧЕСКИХ ИЛИ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, РЕКЛАМАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

#### 4.4 Перечень возможных причин для отказа в гарантийном ремонте:

##### 4.4.1 Наличие внешних повреждений:

4.4.1.1 Деформация корпуса и погружаемой части; вмятины, сколы, забоины на корпусных элементах и полимерном покрытии; повреждения резьбы и иные следы неквалифицированного монтажа/демонтажа;

4.4.1.2 Коррозионные повреждения смачиваемых частей или полимерного покрытия корпуса;

4.4.1.3 Следы перегрева - побежалость на металлических частях, потемнение и оплавление изоляции проводников и/или пластиковых деталей встроенных преобразователей и т.д.;

4.4.1.4 Механические повреждения электронных плат, а также элементов электрической коммутации термопреобразователя – клеммных колодок, разъемов и кабелей (трещины, нарушения изоляции, заломы и т.д.).

4.4.2 Наличие внутренних повреждений:

4.4.2.1 Электрическое или термическое повреждение измерительного элемента;

4.4.2.2 Наличие выгоревших электронных компонентов и элементов электронных плат.

4.4.3 Наличие влаги (или следов ее попадания), пыли и иных загрязнений внутри корпуса.

4.4.4 Электрическое сопротивление изоляции меньше нормы (согласно паспорту на изделие).

4.4.5 Наличие следов самостоятельного ремонта, модернизации; отсутствие или нарушение предупреждающих наклеек.

4.4.6 Некорректное изменение заводских настроек и градуировки;

4.4.7 Нарушение условий транспортирования и хранения.

## 5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование термопреобразователей по ГОСТ 12997.

5.2 Термопреобразователи, упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ, могут транспортироваться на любое расстояние автомобильным, железнодорожным транспортом и в герметизированных отсеках самолетов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, климатические факторы: температура воздуха от плюс 50 °С до минус 50 °С, относительная влажность 100 % при 25 °С) по ГОСТ 15150.

5.3 При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки ящиков в транспортное средство должен исключать их перемещение при транспортировании.

5.4 Термопреобразователи на складах должны храниться в условиях 1 по ГОСТ 15150 (отапливаемое хранилище, климатические факторы: температура воздуха от плюс 40 °С до минус 5 °С, относительная влажность 80 % при 25 °С).

5.5 Распаковку в зимнее время следует производить только в отапливаемом помещении, предварительно выдержав термопреобразователи не распакованными в этом помещении не менее 6 ч.

5.6 В местах хранения термопреобразователей в окружающем воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси и токопроводящая пыль.

## 6 Утилизация

6.1 После окончания срока службы (эксплуатации) термопреобразователь направляют на утилизацию в соответствии с действующим законодательством.

6.2 Термопреобразователь не содержит опасных для здоровья потребителей и окружающей среды материалов. При утилизации термопреобразователя по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

## Приложение А

(обязательное)

Схема составления условного обозначения и модификации  
термопреобразователейА.1 Схема составления условного обозначения термопреобразователей конструктивных исполнений ВТ, ВТ $\alpha$ Преобразователь температуры СТ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ТУ ВУ 390317133.001–2014\*,

где:

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Тип применяемого первичного преобразователя                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R                                                                                                         | – термопреобразователь сопротивления по ГОСТ 6651 (ТС);                                                                                                                                                                                                                                                 |
| U                                                                                                         | – преобразователь термоэлектрический по ГОСТ 6616 с НСХ по СТБ ГОСТ Р 8.585 (ТП)                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 Диаметр защитного корпуса, мм:                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3; 4,5; 5; 6; 8                                                                                           | – CTR – Ø3,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0;<br>– CTU – Ø3,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 Конструктивное исполнение:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ВТ-K= _ мм- _ - _                                                                                         | – конструктивное исполнение, длина вывода (K=70 мм* по умолчанию), для многозонных термопреобразователей указывается длина вывода с индексом 1*, 2, 3 и т.д. через точку с запятой;                                                                                                                     |
| ВТ $\alpha$ -K= _ мм- _ - _                                                                               | – конструктивное исполнение, угол изгиба $\alpha$ , длина вывода (K=70 мм* по умолчанию), для многозонных термопреобразователей указывается длина вывода с индексом 1*, 2, 3 и т.д. через точку с запятой;                                                                                              |
| + SPR                                                                                                     | – защитная пружина по спецификации заказа                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 Длина, код окончания и материал монтажной части:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L= _ мм- _ - _                                                                                            | – длина монтажной части от 20 до 10000 мм с шагом 1 мм или по спецификации заказа, код окончания согласно таблице А.1 и материал* (1.4404 – по умолчанию) согласно таблице А.2, для многозонных термопреобразователей длина указывается с индексом 1*, 2, 3 и т.д. через точку с запятой;               |
| L= _ мм-l= _ мм- _ - _                                                                                    | – длина монтажной части и длина изгиба от 20 до 10000 мм с шагом 1 мм или по спецификации заказа, код окончания согласно таблице А.1 и материал* (1.4404 – по умолчанию) согласно таблице А.2, для многозонных термопреобразователей длина указывается с индексом 1*, 2, 3 и т.д. через точку с запятой |
| 5 Тип монтажного присоединения:                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                                                                                         | – без монтажного соединения*;                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| разъем для термодпары или термосопротивления (розетка и/или вилка), монтажные принадлежности              | – по спецификации заказа                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 Количество (по заказу; по умолчанию n = 1, допускается не обозначать) и тип первичных преобразователей: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| n×Pt 100                                                                                                  | – ТС Pt 100 с $\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                                           |
| n×Pt 500                                                                                                  | – ТС Pt 500 с $\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                                           |
| n×Pt 1000                                                                                                 | – ТС Pt 1000 с $\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                                          |
| n×50 М                                                                                                    | – ТС 50 М с $\alpha=0,00428\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                                             |
| n×100 Н                                                                                                   | – ТС 100 Н с $\alpha=0,00617\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                                            |
| n×J                                                                                                       | – ТП типа J;                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| n×K                                                                                                       | – ТП типа K;                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| n×S                                                                                                       | – ТП типа S;                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| n×T                                                                                                       | – ТП типа T;                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| n×N                                                                                                       | – ТП типа N;                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| n×L                                                                                                       | – ТП типа L                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 Класс допуска:                                                                                                                 |                                                                                                        |
| A, B, C                                                                                                                          | – для ТС;                                                                                              |
| 1, 2, 3                                                                                                                          | – для ТП                                                                                               |
| 8 Схема соединений ТС и исполнение рабочего спая ТП:                                                                             |                                                                                                        |
| 2                                                                                                                                | – двухпроводная (для ТП – не указывается);                                                             |
| 3                                                                                                                                | – трёхпроводная, только для ТС;                                                                        |
| 4                                                                                                                                | – четырёхпроводная, только для ТС;                                                                     |
| O                                                                                                                                | – изолированный, только для ТП;                                                                        |
| Z                                                                                                                                | – заземленный, только для ТП                                                                           |
| 9 Специальное исполнение:                                                                                                        |                                                                                                        |
| Ex                                                                                                                               | – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (при наличии); |
| M                                                                                                                                | – пленочный ЧЭ для платиновых ТС*;                                                                     |
| D                                                                                                                                | – проволоочный ЧЭ для платиновых ТС;                                                                   |
| 3.1                                                                                                                              | – акт приемочного контроля материалов «3.1» согласно EN 10204;                                         |
| NACE                                                                                                                             | – сертификат соответствия требованиям NACE ISO 15156 для материалов, контактирующих с рабочей средой   |
| 10 Диапазон измерений, °C: см. таблицы 1 и 2                                                                                     |                                                                                                        |
| 11 Комплекты (по заказу):                                                                                                        |                                                                                                        |
| O                                                                                                                                | – гильза защитная термометрическая типа O ТУ ВУ 390317133.005;                                         |
| U                                                                                                                                | – устройство закладное типа U ТУ ВУ 390317133.006;                                                     |
| C                                                                                                                                | – соединения трубопроводные резьбовые типа C ТУ ВУ 390317133.004                                       |
| X                                                                                                                                | – по спецификации заказа                                                                               |
| 12 Свидетельство о государственной первичной поверке – Св, протокол государственной первичной поверки – Пр по заказу потребителя |                                                                                                        |
| 13 Кодовое обозначение государств, указывающее страну потребителя: ВУ, KAZ, RU, AZ, UZ и др.*                                    |                                                                                                        |
| * Допускается не обозначать                                                                                                      |                                                                                                        |

Таблица А.1






| Код                                                                                    | Вид окончания | Рисунок окончания монтажной части                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KP*                                                                                    | Плоский       |  |
| KS                                                                                     | Конический    |  |
| KK                                                                                     | Сферический   |  |
| KI                                                                                     | Косой срез    |  |
| * Допускается не обозначать (по умолчанию)                                             |               |                                                                                      |
| Примечание – Для обозначения перфорации монтажной части к коду необходимо добавить – R |               |                                                                                      |

Таблица А.2

| Код    | Наименование материала                                  | Максимальная температура применения, °С |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.4301 | Сталь нержавеющая 1.4301, 08X18H10, AISI 304            | 800                                     |
| 1.4404 | Сталь нержавеющая 1.4404, 10X17H13M2, AISI 316          | 600                                     |
| 1.4841 | Сталь нержавеющая 1.4841, 20X25H20C2, AISI 310          | 1000                                    |
| 1.4571 | Сталь нержавеющая 1.4571, 10X17H13M2T, AISI 316Ti       | 600                                     |
| 1.4541 | Сталь нержавеющая 1.4541, 12X18H10T, 8X18H10T, AISI 321 | 600                                     |
| INC    | Сплав Inconel 2.4816, 600                               | 1150                                    |
| PYR    | Сплав Pyrosil®                                          | 1250                                    |
| NIC    | Сплав Nicrobell®                                        | 1250                                    |
| OXL    | Сплав OMEGACLAD® XL                                     | 1335                                    |
| KAN    | Сплав KANTHAL® AF                                       | 1300                                    |
| SAP    | Монокристалл SAP                                        | 2000                                    |
| 799    | Корунд 799                                              | 1700                                    |
| 610    | Муллит 610                                              | 1400                                    |
| SYL    | Сиалон                                                  | 1450                                    |
| SIC    | Карбид кремния                                          | 1800 (инертные газы)                    |



Конструктивное исполнение ВТ

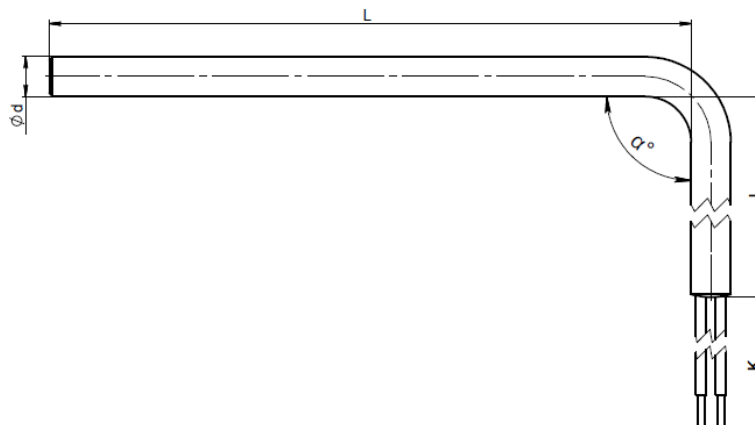
Конструктивное исполнение ВТ $\alpha$ 

Таблица А.3

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, $\varnothing d$ , мм | Длина монтажной части, L, мм                                                                                                               | Длина изгиба, l, мм    | Длина выводов, K, мм   | Угол изгиба, $\alpha$ , ° |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| CTR                              | 3,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0                         | от 50 для диапазона измерений $\leq 200$ °C;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 600$ °C;<br>от 250 для диапазона измерений $> 600$ °C | по спецификации заказа | по спецификации заказа | по спецификации заказа    |
| CTU                              | 3,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0                         | от 20 для диапазона измерений $\leq 200$ °C;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 700$ °C; от 250 для диапазона измерений $> 700$ °C    |                        |                        |                           |

Рисунок А.1 – Термопреобразователи конструктивных исполнений ВТ, ВТ $\alpha$


Преобразователь температуры СТ\_\_-\_\_/\_\_/\_/\_\_/\_\_/\_/\_\_/\_\_/\_/\_\_/\_\_/\_/\_\_/\_\_/\_/\_\_\_\_  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

где:

---

24

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 Класс допуска:                                                                                                                 |                                                                                                        |
| A, B, C                                                                                                                          | – для ТС;                                                                                              |
| 1, 2, 3                                                                                                                          | – для ТП                                                                                               |
| 8 Схема соединений ТС и исполнение рабочего спая ТП:                                                                             |                                                                                                        |
| 2                                                                                                                                | – двухпроводная (для ТП – не указывается)                                                              |
| 3                                                                                                                                | – трёхпроводная, только для ТС;                                                                        |
| 4                                                                                                                                | – четырёхпроводная, только для ТС;                                                                     |
| O                                                                                                                                | – изолированный, только для ТП;                                                                        |
| Z                                                                                                                                | – заземленный, только для ТП                                                                           |
| 9 Специальное исполнение:                                                                                                        |                                                                                                        |
| Ex                                                                                                                               | – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (при наличии); |
| M                                                                                                                                | – пленочный ЧЭ для платиновых ТС*;                                                                     |
| D                                                                                                                                | – проволоочный ЧЭ для платиновых ТС;                                                                   |
| 3.1                                                                                                                              | – акт приемочного контроля материалов «3.1» согласно EN 10204;                                         |
| NACE                                                                                                                             | – сертификат соответствия требованиям NACE ISO 15156 для материалов, контактирующих с рабочей средой   |
| 10 Диапазон измерений, °C: см. таблица 1 и 2                                                                                     |                                                                                                        |
| 11 Комплекты (по заказу):                                                                                                        |                                                                                                        |
| O__                                                                                                                              | – гильза защитная термометрическая типа O ТУ ВУ 390317133.005;                                         |
| U__                                                                                                                              | – устройство закладное типа U ТУ ВУ 390317133.006;                                                     |
| C__                                                                                                                              | – соединения трубопроводные резьбовые типа C ТУ ВУ 390317133.004;                                      |
| X                                                                                                                                | – по спецификации заказа                                                                               |
| 12 Свидетельство о государственной первичной поверке – Св, протокол государственной первичной поверки – Пр по заказу потребителя |                                                                                                        |
| 13 Кодовое обозначение государств, указывающее страну потребителя: BY, KAZ, RU, AZ, UZ и др.*                                    |                                                                                                        |
| * Допускается не обозначать                                                                                                      |                                                                                                        |

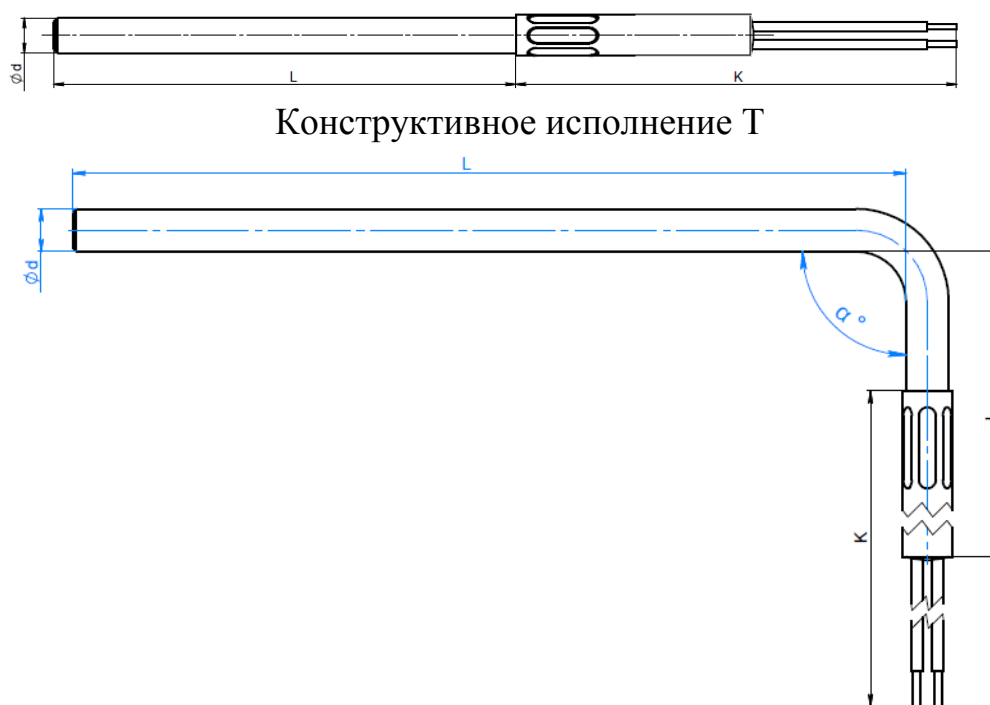

Конструктивное исполнение Та

Таблица А.4

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, Ød, мм | Длина монтажной части, L, мм                                                                                                               | Длина изгиба, l, мм       | Длина кабеля, K, мм       | Угол изгиба, α, °         |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CTR                              | 3,0; 4,5; 5,0;<br>6,0; 8,0        | от 50 для диапазона измерений $\leq 200$ °C;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 600$ °C;<br>от 250 для диапазона измерений $> 600$ °C | по спецификации заказчика | по спецификации заказчика | по спецификации заказчика |
| СТУ                              | 3,0; 4,5; 5,0;<br>6,0; 8,0        | от 20 для диапазона измерений $\leq 200$ °C;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 700$ °C;<br>от 250 для диапазона измерений $> 700$ °C |                           |                           |                           |

Рисунок А.2 – Термопреобразователи конструктивных исполнений Т, Та

Таблица А.5

| Изоляция кабеля                |                        | Параметры кабеля                                                   |                                              |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Код                            | Наименование материала | Описание                                                           | Количество жил/сечение жилы, мм <sup>2</sup> | Внешний диаметр /размеры, мм | Диапазон температуры среды, °С |
| 1                              | 2                      | 3                                                                  | 4                                            | 5                            | 6                              |
| Преобразователи температуры СТ |                        |                                                                    |                                              |                              |                                |
| RS201                          | Силикон                | Гибкие медные жилы, двойная изоляция                               | 2/1,5                                        | 8,0                          | от минус 50 до плюс 200        |
| RS301                          |                        |                                                                    | 3/0,22                                       | 3,6                          |                                |
| RS401                          |                        |                                                                    | 4/0,22                                       | 4,0                          |                                |
| RS302                          |                        |                                                                    | 3/0,22                                       | 2,9                          |                                |
| RS402                          |                        |                                                                    | 4/0,22                                       | 3,0                          |                                |
| RS303                          |                        |                                                                    | 3/1,0                                        | 7,0                          |                                |
| RT107                          | Тефлон                 | Гибкие медные жилы, изоляция                                       | 1/0,24                                       | 1,12                         | от минус 75 до плюс 250        |
| RT108                          |                        | Гибкие никелированные медные жилы, изоляция                        | 1/0,24                                       | 1,12                         |                                |
| RT301                          |                        | Гибкие медные жилы, экранированные, двойная изоляция               | 3/0,22                                       | 3,0                          |                                |
| RT401                          |                        |                                                                    | 4/0,22                                       | 3,2                          |                                |
| RT302                          |                        | Гибкие медные жилы, двойная изоляция, оплетка из нержавеющей стали | 3/0,22                                       | 3,0                          |                                |
| RT402                          |                        |                                                                    | 4/0,22                                       | 3,2                          |                                |
| RT203                          |                        |                                                                    | 2/2x7/0,18                                   | 2,0x3,0                      |                                |
| RT405                          |                        | Гибкие медные жилы, двойная изоляция                               | 4/0,05                                       | 2,6                          |                                |
| RT204                          |                        |                                                                    | 2/0,22                                       | 1,07x1,73                    |                                |
| RT404                          |                        |                                                                    | 4/0,22                                       | 2,1                          |                                |
| RT406                          |                        |                                                                    | 4/0,22                                       | 3,0                          |                                |
| RW301                          | Стекловолоконно        | Гибкие медные жилы, двойная изоляция, оплетка из нержавеющей стали | 3/0,22                                       | 3,2                          | от минус 60 до плюс 400        |
| RW401                          |                        |                                                                    | 4/0,22                                       | 3,5                          |                                |
| RW202                          |                        | Гибкие медные жилы, двойная изоляция                               | 2/0,22                                       | 1,5x2,5                      | от минус 60 до плюс 480        |
| RW203                          |                        |                                                                    | 2/0,22                                       | 1,52x1,32                    |                                |
| RW403                          |                        | Гибкие медные жилы, двойная изоляция, медная оплетка               | 4/0,22                                       | 1,52x1,66                    | от минус 60 до плюс 400        |
| RW204                          |                        |                                                                    | 2/0,22                                       | 2,8                          |                                |
| RK402                          | Kapton®                | Гибкие медные жилы, двойная изоляция                               | 4/0,22                                       | 2,1                          | от минус 75 до плюс 350        |
| RK103                          |                        | Гибкие медные жилы, изоляция                                       | 1/0,22                                       | 0,9                          |                                |
| RK104                          |                        |                                                                    | 1/0,07                                       | 0,5                          |                                |
| RP301                          | PVC                    | Гибкие медные жилы, экранированные, двойная изоляция               | 3/0,25                                       | 4,0                          | от минус 30 до плюс 105        |
| RP302                          |                        |                                                                    | 3/0,5                                        | 5,5                          |                                |

Продолжение таблицы А.5

| 1                              | 2                  | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6                       |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|
| Преобразователи температуры СТ |                    |                                                                                                               |        |          |                         |
| TS201                          | Силикон            | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция                               | 2/0,22 | 3,8      | от минус 50 до плюс 200 |
| TS401                          |                    |                                                                                                               | 4/0,22 | 4,4      |                         |
| TS202                          |                    |                                                                                                               | 2/0,5  | 5,0      |                         |
| TS402                          |                    |                                                                                                               | 4/0,5  | 5,0      |                         |
| TS203                          |                    |                                                                                                               | 2/0,75 | 6,2      |                         |
| TS204                          |                    |                                                                                                               | 2/1,0  | 6,2      |                         |
| TS205                          |                    |                                                                                                               | 2/1,5  | 8,0      |                         |
| TS206                          |                    | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция, медная оплетка               | 2/0,22 | 4,3      |                         |
| TS207                          |                    |                                                                                                               | 2/0,5  | 5,5      |                         |
| TS208                          |                    | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, экранированные, двойная изоляция               | 2/1,0  | 7,2      |                         |
| TS209                          |                    |                                                                                                               | 2/0,75 | 6,4      |                         |
| TS210                          |                    |                                                                                                               | 2/0,5  | 4,7      |                         |
| TS211                          |                    | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция, медная оплетка               | 2/1,5  | 7,0      |                         |
| TS212                          |                    |                                                                                                               | 2/1,5  | 8,8      |                         |
| TT201                          | Тефлон             | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция                               | 2/0,22 | 2,5x1,5  | от минус 75 до плюс 250 |
| TT202                          |                    | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, изоляция                                       | 2/0,03 | 1,0      |                         |
| TT203                          |                    |                                                                                                               | 2/0,22 | 2,1      |                         |
| TT204                          |                    | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция, оплетка из нержавеющей стали | 2/0,22 | 2,0x3,0  |                         |
| TT205                          |                    | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция                               | 2/0,2  | 2,5x1,5  |                         |
| TT206                          |                    |                                                                                                               | 2/0,08 | 1,0x1,5  |                         |
| TT207                          |                    | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, экранированные, двойная изоляция               | 2/0,22 | 3,0      |                         |
| TT208                          |                    | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция, оплетка из нержавеющей стали | 2/0,5  | 6,0      |                         |
| TW201                          | Стеклово-<br>локно | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция                               | 2/0,22 | 1,5x2,5  | от минус 60 до плюс 400 |
| TW202                          |                    |                                                                                                               | 2/1,0  | 2,5x4,0  |                         |
| TW203                          |                    |                                                                                                               | 2/1,5  | 4,2x2,2  |                         |
| TW204                          |                    | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция, оплетка из нержавеющей стали | 2/0,22 | 2,3      |                         |
| TW404                          |                    |                                                                                                               | 4/0,22 | 4,6      |                         |
| TW206                          |                    |                                                                                                               | 2/1,0  | 8,4      |                         |
| TW205                          |                    | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция                               | 2/0,2  | 1,8      |                         |
| TW211                          |                    |                                                                                                               | 2/0,08 | 1,3x1,37 |                         |

## Продолжение таблицы А.5

| 1     | 2                                     | 3                                                                                                    | 4      | 5       | 6                           |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|
| TW210 | Стеклово-<br>локно                    | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция, оплетка медная      | 2/0,5  | 4,2     |                             |
| TW207 | Кварцевое<br>волокно                  | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция                      | 2/0,2  | 3,0     | от минус 60<br>до плюс 900  |
| TW208 | Керамиче-<br>ское во-<br>локно        |                                                                                                      | 2/0,5  | 2,0x3,0 | от минус 60<br>до плюс 1200 |
| TW209 |                                       |                                                                                                      | 2/0,5  | 3,2x1,8 |                             |
| TP201 | PVC                                   | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция                      | 2/0,22 | 4,0     | от минус 30<br>до плюс 105  |
| TP202 |                                       |                                                                                                      | 2/0,75 | 6,0     |                             |
| TP203 |                                       |                                                                                                      | 2/1,0  | 6,0     |                             |
| TP401 |                                       | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция, оплетка медная      | 4/0,5  | 8,0     |                             |
| TK201 | Kapton®                               | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары, двойная изоляция                      | 2/0,2  | 3,0x1,5 | от минус 60<br>до плюс 400  |
| TK202 |                                       |                                                                                                      | 2/0,08 | 0,9x1,5 |                             |
| TK203 |                                       |                                                                                                      | 2/0,32 | 1,2x0,7 |                             |
| TK204 |                                       |                                                                                                      | 2/0,22 | 1,8x1,0 |                             |
| TA203 | Нержаве-<br>ющая<br>сталь<br>AISI 316 | Гибкие термоэлектродные жилы в соответствии с типом термопары в защитной трубке из нержавеющей стали | 2/0,35 | 3,0     | от минус 75<br>до плюс 600  |

Примечания:

1) Размеры для справок;

2) Термопреобразователи всех модификаций могут быть изготовлены с кабелями других конструкций и материалов по заказу потребителей. Условное обозначение – по согласованию с потребителем

Преобразователь температуры СТ   -  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

где:

---

30

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 Класс допуска:                                                                                                                 |                                                                                                        |
| A, B, C                                                                                                                          | – для ТС;                                                                                              |
| 1, 2, 3                                                                                                                          | – для ТП                                                                                               |
| 8 Схема соединений ТС и исполнение рабочего спая ТП:                                                                             |                                                                                                        |
| 2                                                                                                                                | – двухпроводная (для ТП – не указывается);                                                             |
| 3                                                                                                                                | – трёхпроводная, только для ТС;                                                                        |
| 4                                                                                                                                | – четырёхпроводная, только для ТС;                                                                     |
| O                                                                                                                                | – изолированный, только для ТП;                                                                        |
| Z                                                                                                                                | – заземленный, только для ТП                                                                           |
| 9 Специальное исполнение:                                                                                                        |                                                                                                        |
| Ex                                                                                                                               | – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (при наличии); |
| M                                                                                                                                | – пленочный ЧЭ для платиновых ТС*;                                                                     |
| D                                                                                                                                | – проволоочный ЧЭ для платиновых ТС;                                                                   |
| 3.1                                                                                                                              | – акт приемочного контроля материалов «3.1» согласно EN 10204;                                         |
| NACE                                                                                                                             | – сертификат соответствия требованиям NACE ISO 15156 для материалов, контактирующих с рабочей средой   |
| 10 Диапазон измерений, °C: см. таблицы 1 и 2                                                                                     |                                                                                                        |
| 11 Комплекты (по заказу):                                                                                                        |                                                                                                        |
| O__                                                                                                                              | – гильза защитная термометрическая типа O ТУ ВУ 390317133.005;                                         |
| U__                                                                                                                              | – устройство закладное типа U ТУ ВУ 390317133.006;                                                     |
| C__                                                                                                                              | – соединения трубопроводные резьбовые типа C ТУ ВУ 390317133.004;                                      |
| X                                                                                                                                | – по спецификации заказа                                                                               |
| 12 Свидетельство о государственной первичной поверке – Св, протокол государственной первичной поверки – Пр по заказу потребителя |                                                                                                        |
| 13 Кодовое обозначение государств, указывающее страну потребителя: BY, KAZ, RU, AZ, UZ и др.*                                    |                                                                                                        |
| * Допускается не обозначать                                                                                                      |                                                                                                        |

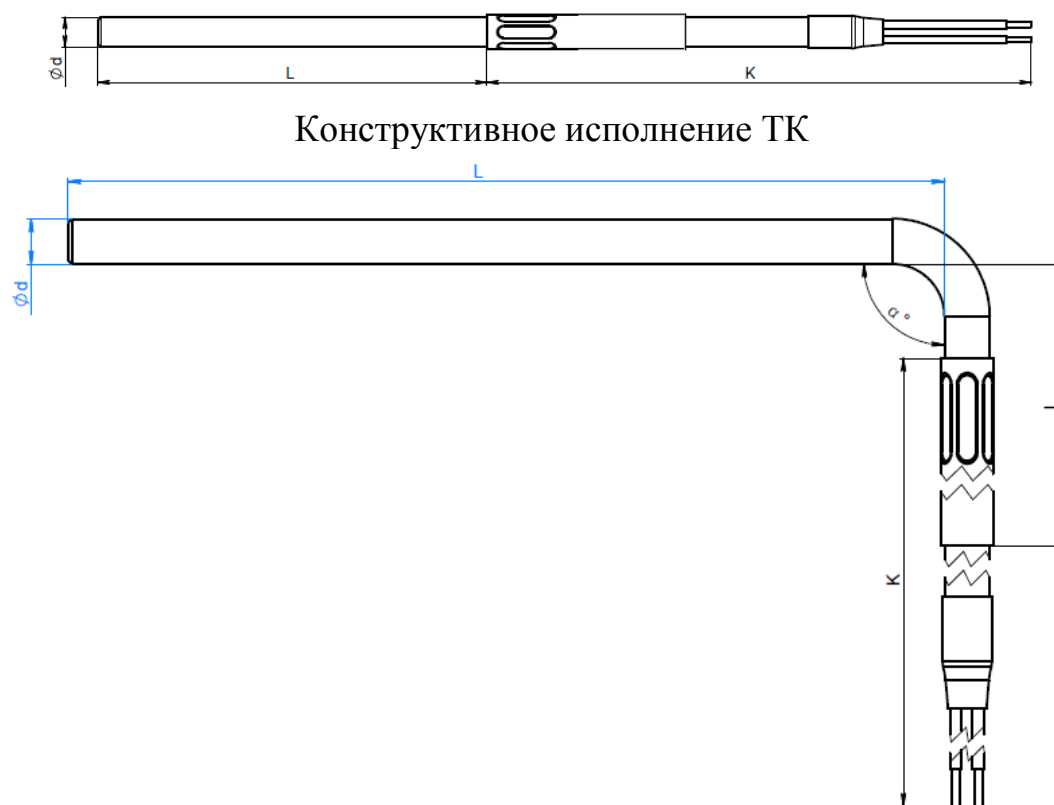
Конструктивное исполнение ТК $\alpha$ 

Таблица А.6

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, $\varnothing d$ , мм   | Длина монтажной части, L, мм                                                                                                               | Длина изгиба, l, мм    | Длина кабеля, K, мм    | Угол изгиба, $\alpha$ , ° |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| CTR                              | 3,0; 4,5; 6,0; 8,0                                | от 50 для диапазона измерений $\leq 200$ °С;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 600$ °С;<br>от 250 для диапазона измерений $> 600$ °С | по спецификации заказа | по спецификации заказа | по спецификации заказа    |
| CTU                              | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0;<br>3,0; 4,5; 5,0; 6,0;<br>8,0 | от 20 для диапазона измерений $\leq 200$ °С;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 700$ °С;<br>от 250 для диапазона измерений $> 700$ °С |                        |                        |                           |

Рисунок А.3 – Термопреобразователи конструктивных исполнений ТК, ТК $\alpha$


Преобразователь температуры СТ\_ - / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_  

12345678910111213

где:

33

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 Специальное исполнение:                                                                                                        |                                                                                                        |
| Ex                                                                                                                               | – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (при наличии); |
| M                                                                                                                                | – пленочный ЧЭ для платиновых ТС*;                                                                     |
| D                                                                                                                                | – проволочный ЧЭ для платиновых ТС;                                                                    |
| 3.1                                                                                                                              | – акт приемочного контроля материалов «3.1» согласно EN 10204;                                         |
| NACE                                                                                                                             | – сертификат соответствия требованиям NACE ISO 15156 для материалов, контактирующих с рабочей средой   |
| 10 Диапазон измерений, °C: см. таблицы 1 и 2                                                                                     |                                                                                                        |
| 11 Комплекты (при наличии):                                                                                                      |                                                                                                        |
| O                                                                                                                                | – гильза защитная термометрическая типа O ТУ ВУ 390317133.005;                                         |
| U                                                                                                                                | – устройство закладное типа U ТУ ВУ 390317133.006;                                                     |
| C                                                                                                                                | – соединения трубопроводные резьбовые типа C ТУ ВУ 390317133.004;                                      |
| X                                                                                                                                | – по спецификации заказа                                                                               |
| 12 Свидетельство о государственной первичной поверке – Св, протокол государственной первичной поверки – Пр по заказу потребителя |                                                                                                        |
| 13 Кодовое обозначение государств, указывающее страну потребителя: ВУ, KAZ, RU, AZ, UZ и др.*                                    |                                                                                                        |
| * Допускается не обозначать                                                                                                      |                                                                                                        |

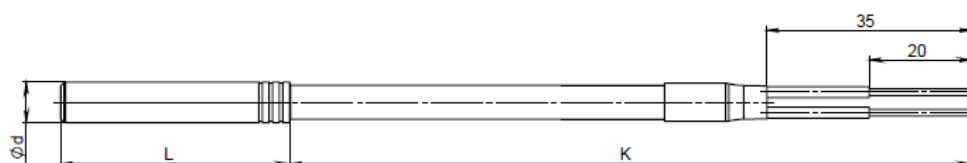

Конструктивное исполнение Е1

Таблица А.7

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, $\varnothing d$ , мм | Длина монтажной части, L, мм                                                                                                               | Длина кабеля, K, мм    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CTR                              | 4; 5; 6; 8; 10                                  | от 50 для диапазона измерений $\leq 200$ °C;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 600$ °C;<br>от 250 для диапазона измерений $> 600$ °C | по спецификации заказа |
| CTU                              |                                                 | от 20 для диапазона измерений $\leq 200$ °C;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 700$ °C;<br>от 250 для диапазона измерений $> 700$ °C |                        |


Рисунок А.4 – Термопреобразователи конструктивного исполнения Е1

[illegible]

где:

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Тип применяемого первичного преобразователя                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R                                                                                                         | – термопреобразователь сопротивления по ГОСТ 6651 (ТС);                                                                                                                                                                                                                                      |
| U                                                                                                         | – преобразователь термоэлектрический по ГОСТ 6616 с НСХ по СТБ ГОСТ Р 8.585 (ТП)                                                                                                                                                                                                             |
| 2 Диаметр защитного корпуса, мм:                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6; 8                                                                                                      | – Ø6,0; 8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 Конструктивное исполнение:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E2-K= __ мм __ -<br>__ мм-__                                                                              | – конструктивное исполнение, длина кабеля, для многозонных термопреобразователей указывается длина кабеля с индексом 1*, 2, 3 и т.д. через точку с запятой, код кабеля согласно таблице А.5, длина пружины* (200 мм – по умолчанию) и материал* (1.4404 – по умолчанию) согласно таблице А.2 |
| 4 Длина, код окончания и материал монтажной части:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L= _ мм-__ - __                                                                                           | – длина монтажной части от 20 до 10000 мм с шагом 1 мм или по спецификации заказа, код окончания согласно таблице А.9 и материал* (1.4404 – по умолчанию) согласно таблице А.2, для многозонных термопреобразователей длина указывается с индексом 1*, 2, 3 и т.д. через точку с запятой     |
| 5 Тип монтажного присоединения:                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                                                                                         | – без монтажного присоединения*;                                                                                                                                                                                                                                                             |
| разъем для термопары или термосопротивления (розетка и/или вилка), монтажные принадлежности               | по спецификации заказа;                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M__                                                                                                       | – резьба байонетного соединения M10x1; M12x1,25; M12x1,5; M14x1, M__ (по спецификации заказа)                                                                                                                                                                                                |
| 6 Количество (по заказу; по умолчанию n = 1, допускается не обозначать) и тип первичных преобразователей: |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| n×Pt 100                                                                                                  | – ТС Pt 100 с $\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                                |
| n×Pt 500                                                                                                  | – ТС Pt 500 с $\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                                |
| n×Pt 1000                                                                                                 | – ТС Pt 1000 с $\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                               |
| n×50 М                                                                                                    | – ТС 50 М с $\alpha=0,00428\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                                  |
| n×100 Н                                                                                                   | – ТС 100 Н с $\alpha=0,00617\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                                 |
| n×J                                                                                                       | – ТП типа J;                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| n×K                                                                                                       | – ТП типа K;                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| n×T                                                                                                       | – ТП типа T                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 Класс допуска:                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A, B, C                                                                                                   | – для ТС;                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1, 2, 3                                                                                                   | – для ТП                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 Схема соединений ТС и исполнение рабочего спая ТП:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                                                                                                         | – двухпроводная (для ТП – не указывается);                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                                                                                                         | – трёхпроводная, только для ТС;                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                                                                                                         | – четырёхпроводная, только для ТС;                                                                                                                                                                                                                                                           |
| O                                                                                                         | – изолированный, только для ТП;                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Z                                                                                                         | – заземленный, только для ТП                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 Специальное исполнение:                                                                                                        |                                                                                                        |
| Ex                                                                                                                               | – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (при наличии); |
| M                                                                                                                                | – пленочный ЧЭ для платиновых ТС*;                                                                     |
| D                                                                                                                                | – проволочный ЧЭ для платиновых ТС;                                                                    |
| 3.1                                                                                                                              | – акт приемочного контроля материалов «3.1» согласно EN 10204;                                         |
| NACE                                                                                                                             | – сертификат соответствия требованиям NACE ISO 15156 для материалов, контактирующих с рабочей средой   |
| 10 Диапазон измерений, °C: см. таблицы 1 и 2                                                                                     |                                                                                                        |
| 11 Комплекты (по заказу):                                                                                                        |                                                                                                        |
| O                                                                                                                                | – гильза защитная термометрическая типа O ТУ ВУ 390317133.005;                                         |
| U                                                                                                                                | – устройство закладное типа U ТУ ВУ 390317133.006;                                                     |
| C                                                                                                                                | – соединения трубопроводные резьбовые типа C ТУ ВУ 390317133.004                                       |
| X                                                                                                                                | – по спецификации заказа                                                                               |
| 12 Свидетельство о государственной первичной поверке – Св, протокол государственной первичной поверки – Пр по заказу потребителя |                                                                                                        |
| 13 Кодовое обозначение государств, указывающее страну потребителя: ВУ, KAZ, RU, AZ, UZ и др.*                                    |                                                                                                        |
| * Допускается не обозначать                                                                                                      |                                                                                                        |

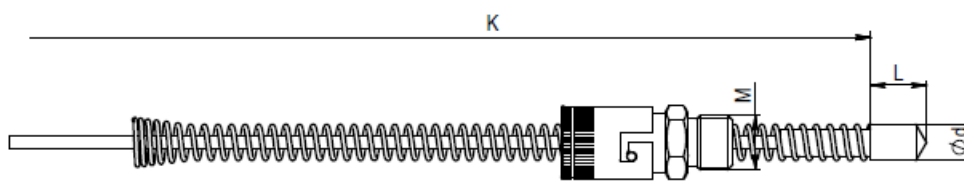







### Конструктивные исполнения E2

Таблица А.8

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, $\varnothing d$ , мм | Длина монтажной части, L, мм                                                                                                               | Длина кабеля, K, мм    | Резьба байонетного соединения, M, мм                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CTR                              | 6,0; 8,0                                        | от 30 для диапазона измерений $\leq 200$ °C;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 600$ °C;<br>от 250 для диапазона измерений $> 600$ °C | по спецификации заказа | M10x1; M12x1,25;<br>M12x1,5; M14x1,<br>M__ (по спецификации заказа) |
| CTU                              |                                                 | от 20 для диапазона измерений $\leq 200$ °C;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 700$ °C;<br>от 250 для диапазона измерений $> 700$ °C |                        |                                                                     |

Рисунок А.5 – Термопреобразователи конструктивного исполнения E2

Таблица А.9


| Код                                                                                                            | Диаметр пружины, мм | Рисунок и размеры окончания монтажной части                                          | Диаметр окончания, $\varnothing d$ , мм |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| KP1                                                                                                            | $\varnothing 6$     |    | 6                                       |
| KS2                                                                                                            | $\varnothing 6$     |    | 6                                       |
| KK3                                                                                                            | $\varnothing 6$     |    | 6                                       |
| KP4                                                                                                            | $\varnothing 8$     |    | 8                                       |
| KS5                                                                                                            | $\varnothing 8$     |    | 8                                       |
| KK6                                                                                                            | $\varnothing 8$     |   | 8                                       |
| KP7                                                                                                            | $\varnothing 8$     |  | 6                                       |
| KS8                                                                                                            | $\varnothing 8$     |  | 6                                       |
| KK9                                                                                                            | $\varnothing 8$     |  | 6                                       |
| Примечание – По требованию заказчика допускается изготовление окончания монтажной части других размеров и форм |                     |                                                                                      |                                         |

Преобразователь температуры СТ\_ - / / / / / / / / / / / / / / / /  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

где:

38

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 Специальное исполнение:                                                                                                        |                                                                                                        |
| Ex                                                                                                                               | – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (при наличии); |
| M                                                                                                                                | – пленочный ЧЭ для платиновых ТС*;                                                                     |
| D                                                                                                                                | – проволочный ЧЭ для платиновых ТС;                                                                    |
| 3.1                                                                                                                              | – акт приемочного контроля материалов «3.1» согласно EN 10204;                                         |
| NACE                                                                                                                             | – сертификат соответствия требованиям NACE ISO 15156 для материалов, контактирующих с рабочей средой   |
| 10 Диапазон измерений, °C: см. таблицы 1 и 2                                                                                     |                                                                                                        |
| 11 Комплекты (по заказу):                                                                                                        |                                                                                                        |
| O                                                                                                                                | – гильза защитная термометрическая типа O ТУ ВУ 390317133.005;                                         |
| U                                                                                                                                | – устройство закладное типа U ТУ ВУ 390317133.006;                                                     |
| C                                                                                                                                | – соединения трубопроводные резьбовые типа C ТУ ВУ 390317133.004;                                      |
| X                                                                                                                                | – по спецификации заказа                                                                               |
| 12 Свидетельство о государственной первичной поверке – Св, протокол государственной первичной поверки – Пр по заказу потребителя |                                                                                                        |
| 13 Кодовое обозначение государств, указывающее страну потребителя: ВУ, KAZ, RU, AZ, UZ и др.*                                    |                                                                                                        |
| * Допускается не обозначать                                                                                                      |                                                                                                        |

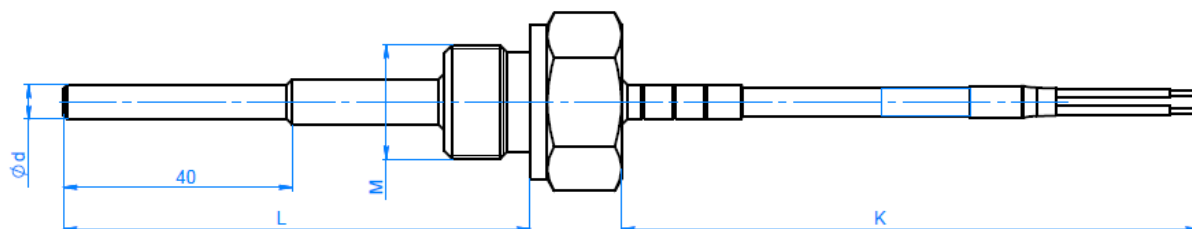

### Конструктивное исполнение GE1

Таблица А.10

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, Ød, мм | Длина монтажной части, L, мм                                                                                                | Длина кабеля, K, мм    | Тип монтажного присоединения, M                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CTR                              | 4,0; 5,0;<br>6,0; 8,0;<br>10,0    | от 60 для диапазона измерений ≤200 °C;<br>от 200 для диапазона измерений ≤600 °C;<br>от 250 для диапазона измерений >600 °C | по спецификации заказа | Резьбовое присоединение M27×2; M20×1,5; M18×1,5; M12×1,5; M14×1,25; M___ (по спецификации заказа); G ½"; G 1"; G_ (по спецификации заказа); ½NPT; ¼NPT; _NPT (по спецификации заказа); ½"-20UNF; __UNF (по спецификации заказа) |
| CTU                              |                                   | от 60 для диапазона измерений ≤200 °C;<br>от 200 для диапазона измерений ≤700 °C;<br>от 250 для диапазона измерений >700 °C |                        |                                                                                                                                                                                                                                 |

Рисунок А.6 – Термопреобразователи конструктивного исполнения GE1

### А.7 Схема составления условного обозначения термопреобразователей модификации СТР конструктивного исполнения В

Преобразователь температуры СТ\_\_-\_\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_  


12345678910111213

TY BY 390317133.001–2014\*,

где:

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Тип применяемого первичного преобразователя                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R                                                                                                          | – термопреобразователь сопротивления по ГОСТ 6651 (ТС)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 Диаметр защитного корпуса:                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4; 5; 6; 8; 10                                                                                             | – Ø4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 мм                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 Конструктивное исполнение:                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B-K= ___ мм-___                                                                                            | – конструктивное исполнение, длина кабеля, для многозонных термопреобразователей указывается длина кабеля с индексом 1*, 2, 3 и т.д. через точку с запятой, код кабеля согласно таблице А.5;                                                                                             |
| +SPR                                                                                                       | – защитная пружина по спецификации заказа                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 Длина, код окончания и материал монтажной части                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L= _ мм-_- _                                                                                               | – длина монтажной части от 60 до 100000 мм с шагом 1 мм или по спецификации заказа, код окончания согласно таблице А.1 и материал*(1.4404 – по умолчанию) согласно таблице А.2, для многозонных термопреобразователей длина указывается с индексом 1*, 2, 3 и т.д. через точку с запятой |
| 5 Тип монтажного присоединения:                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M_                                                                                                         | – резьбовое присоединение M27×2; M20×1,5; M18×1,5; M12×1,5; M14×1,25; M_ (по спецификации заказа);                                                                                                                                                                                       |
| G_                                                                                                         | – резьбовое присоединение G½"; G1"; G_ (по спецификации заказа);                                                                                                                                                                                                                         |
| _NPT                                                                                                       | – резьбовое присоединение ½NPT; ¼NPT; _NPT (по спецификации заказа)                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 Количество (по заказу; по умолчанию n = 1, допускается не обозначать,) и тип первичных преобразователей: |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| n×Pt 100                                                                                                   | – ТС Pt 100 с α=0,00385 °C <sup>-1</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                               |
| n×Pt 500                                                                                                   | – ТС Pt 500 с α=0,00385 °C <sup>-1</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                               |
| n×Pt 1000                                                                                                  | – ТС Pt 1000 с α=0,00385 °C <sup>-1</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                              |
| n×50 М                                                                                                     | – ТС 50 М с α=0,00428 °C <sup>-1</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                 |
| n×100 Н                                                                                                    | – ТС 100 Н с α=0,00617 °C <sup>-1</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 Класс допуска:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A, B, C                                                                                                    | – для ТС                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 Схема соединений ТС:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                                                                                          | – двухпроводная;                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                                                                                                          | – трёхпроводная;                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                                                                                                          | – четырёхпроводная                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 Специальное исполнение:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ex                                                                                                         | – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (при наличии);                                                                                                                                                                                   |
| M                                                                                                          | – пленочный ЧЭ для платиновых ТС*;                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D                                                                                                          | – проволочный ЧЭ для платиновых ТС;                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1                                                                                                        | – акт приемочного контроля материалов «3.1» согласно EN 10204;                                                                                                                                                                                                                           |
| NACE                                                                                                       | – сертификат соответствия требованиям NACE ISO 15156 для материалов, контактирующих с рабочей средой                                                                                                                                                                                     |
| 10 Диапазон измерений, °C: см. таблицу 1                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                  |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 11 Комплекты (при наличии):                                                                                                      |                                                                   |
| О                                                                                                                                | – гильза защитная термометрическая типа О ТУ ВУ 390317133.005;    |
| U                                                                                                                                | – устройство закладное типа U ТУ ВУ 390317133.006;                |
| С                                                                                                                                | – соединения трубопроводные резьбовые типа С ТУ ВУ 390317133.004; |
| X                                                                                                                                | – по спецификации заказа                                          |
| 12 Свидетельство о государственной первичной поверке – Св, протокол государственной первичной поверки – Пр по заказу потребителя |                                                                   |
| 13 Кодовое обозначение государств, указывающее страну потребителя: ВУ, KAZ, RU, AZ, UZ и др.*                                    |                                                                   |
| * Допускается не обозначать                                                                                                      |                                                                   |

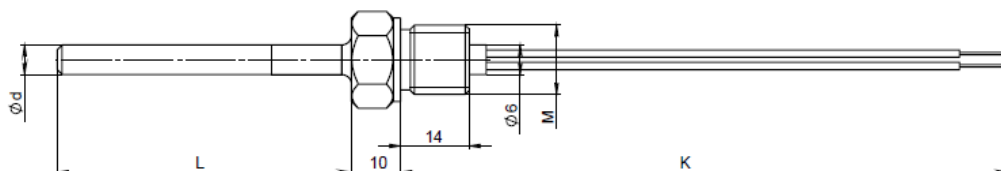

Конструктивное исполнение В

Таблица А.11

| Диаметр защитного корпуса, Ød, мм | Длина монтажной части, L, мм                                                                                                               | Длина кабеля, K, мм    | Тип монтажного присоединения, M                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,0; 5,0; 6,0; 8,0;<br>10,0       | от 60 для диапазона измерений $\leq 200$ °C;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 600$ °C;<br>от 250 для диапазона измерений $> 600$ °C | по спецификации заказа | Резьбовое присоединение M27×2; M20×1,5; M18×1,5; M12×1,5; M14×1,25; M____ (по спецификации заказа); G ½"; G 1"; G_ (по спецификации заказа); ½NPT; ¼NPT; _NPT (по спецификации заказа) |

Рисунок А.7 – Термопреобразователи модификации СТР конструктивного исполнения В

Преобразователь температуры СТ\_\_-\_\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

где:

---

42

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 Оснащение конструктивного исполнения W:                                                                                        |                                                                                                                                                  |
| WO*                                                                                                                              | – без оснащения;                                                                                                                                 |
| KZ                                                                                                                               | – колодка зажимная KZ                                                                                                                            |
| 10 Диапазон измерений, °C: см. таблицы 1 – 2                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| 11 Комплекты (по спецификации заказа):                                                                                           |                                                                                                                                                  |
| O                                                                                                                                | – гильза защитная термометрическая типа O ТУ ВУ 390317133.005;                                                                                   |
| U                                                                                                                                | – устройство закладное типа U ТУ ВУ 390317133.006;                                                                                               |
| C                                                                                                                                | – соединения трубопроводные резьбовые типа C ТУ ВУ 390317133.004;                                                                                |
| PCP                                                                                                                              | – универсальное приспособление для термопреобразователей для монтажа в любом положении на конструкции или горизонтальной трубе от Ø25 до Ø31 мм; |
| W                                                                                                                                | – пластина маркировочная;                                                                                                                        |
| X                                                                                                                                | – по спецификации заказа                                                                                                                         |
| 12 Свидетельство о государственной первичной поверке – Св, протокол государственной первичной поверки – Пр по заказу потребителя |                                                                                                                                                  |
| 13 Кодовое обозначение государств, указывающее страну потребителя: BY, KAZ, RU, AZ, UZ и др.*                                    |                                                                                                                                                  |
| * Допускается не обозначать                                                                                                      |                                                                                                                                                  |

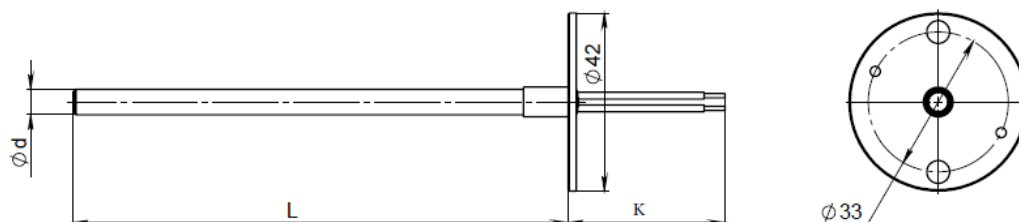


Таблица А.12

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, Ød, мм | Длина монтажной части, L, мм                                                                                                               | Длина вывода, K, мм    |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CTR                              | 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0      | от 50 для диапазона измерений $\leq 200$ °C;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 600$ °C;<br>от 250 для диапазона измерений $> 600$ °C | по спецификации заказа |
| CTU                              | 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0      | от 40 для диапазона измерений $\leq 200$ °C;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 700$ °C;<br>от 250 для диапазона измерений $> 700$ °C |                        |

Рисунок А.8 – Термопреобразователи конструктивного исполнения W

### А.9 Схема составления условного обозначения термопреобразователей СТР с монтажной головкой из алюминия, нержавеющей стали или полимеров


Преобразователь температуры СТ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ТУ ВУ 390317133.001–2014\*,

где:

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Тип применяемых первичных преобразователей                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R                                                                                                          | – термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651 (ТС);                                                                                                                                                                                                                                  |
| U                                                                                                          | – преобразователи термоэлектрические по ГОСТ 6616 с НСХ по СТБ ГОСТ Р 8.585 (ТП)                                                                                                                                                                                                         |
| 2 Диаметр защитного корпуса, мм                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3; 4; 4,5; 5; 6; 8; 10; 11                                                                                 | CTR – Ø3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0;<br>CTU – Ø3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 11,0                                                                                                                                                                                                  |
| 3 Длина, код окончания и материал монтажной части:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L= _ мм-__-__                                                                                              | – длина монтажной части от 50 до 10000 мм с шагом 1 мм или по спецификации заказа, код окончания согласно таблице А.1 и материал* (1.4404 – по умолчанию) согласно таблице А.2, для многосонных термопреобразователей длина указывается с индексом 1*, 2, 3 и т.д. через точку с запятой |
| 4 Вынесение монтажной головки, мм:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S= мм-__                                                                                                   | – от 50 до 500 мм с шагом 1 мм; по спецификации заказа                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 Тип монтажного присоединения:                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Z*                                                                                                         | – без монтажного присоединения;                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M_                                                                                                         | – резьбовое присоединение M27×2; M20×1,5; M18×1,5; M12×1,5; M14×1,25; M__ (по спецификации заказа);                                                                                                                                                                                      |
| G_                                                                                                         | – резьбовое присоединение G½"; G1"; G__ (по спецификации заказа);                                                                                                                                                                                                                        |
| _NPT                                                                                                       | – резьбовое присоединение ½NPT; ¼NPT; __NPT (по спецификации заказа);                                                                                                                                                                                                                    |
| DN 25 PN 16; DN 25 PN 40; DN 50 PN 16;<br>DN 50 PN 40                                                      | – фланцевое присоединение (по спецификации заказа);                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tri-Clamp 1"; Tri-Clamp 1,5"; Tri-Clamp 2";<br>DIN 25; DIN 40; DIN 50                                      | – гигиеническое присоединение (по спецификации заказа)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 Вариант установки первичного преобразователя (для термопреобразователей с монтажной головкой):           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GB                                                                                                         | – исполнение с подвижным вкладышем без вынесения монтажной головки;                                                                                                                                                                                                                      |
| GN                                                                                                         | – исполнение с подвижным вкладышем с вынесением монтажной головки;                                                                                                                                                                                                                       |
| TB                                                                                                         | – исполнение сварное без вынесения монтажной головки;                                                                                                                                                                                                                                    |
| TN                                                                                                         | – исполнение сварное с вынесением монтажной головки;                                                                                                                                                                                                                                     |
| PS                                                                                                         | – исполнение с подвижным штуцером                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 Количество (по заказу; по умолчанию n = 1, допускается не обозначать,) и тип первичных преобразователей: |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| n×Pt 100                                                                                                   | – ТС Pt 100 с $\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                            |
| n×Pt 500                                                                                                   | – ТС Pt 500 с $\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                            |
| n×Pt 1000                                                                                                  | – ТС Pt 1000 с $\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                           |
| n×50 M                                                                                                     | – ТС 50 M с $\alpha=0,00428\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                              |
| n×100 H                                                                                                    | – ТС 100 H с $\alpha=0,00617\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;                                                                                                                                                                                                                             |
| n×J                                                                                                        | – ТП типа J;                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n×K                                                                                                        | – ТП типа K;                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n×S                                                                                                        | – ТП типа S;                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n×T                                                                                                        | – ТП типа T;                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n×N                                                                                                        | – ТП типа N;                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n×L                                                                                                        | – ТП типа L                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 Класс допуска (указывается для оснащения монтажной головки WO, KZ):                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A, B, C                                                                                                    | – для ТС;                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1, 2, 3                                                                                                    | – для ТП                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 Схема соединений ТС и исполнение рабочего спая ТП:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                                                                                                                                | – двухпроводная (для ТП – не указывается);                                                                                                                                                                                                      |
| 3                                                                                                                                | – трёхпроводная, только для ТС;                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                                                                                                                                | – четырёхпроводная, только для ТС;                                                                                                                                                                                                              |
| О                                                                                                                                | – изолированный, только для ТП;                                                                                                                                                                                                                 |
| Z                                                                                                                                | – заземленный, только для ТП                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 Специальное исполнение:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ex                                                                                                                               | – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (при наличии);                                                                                                                                          |
| Exd                                                                                                                              | – взрывобезопасное исполнение в виде взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», «пыленепроницаемая оболочка» (при наличии);                                                                                                                   |
| M                                                                                                                                | – пленочный ЧЭ для платиновых ТС*;                                                                                                                                                                                                              |
| D                                                                                                                                | – проволочный ЧЭ для платиновых ТС;                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1                                                                                                                              | – акт приемочного контроля материалов «3.1» согласно EN 10204;                                                                                                                                                                                  |
| NACE                                                                                                                             | – сертификат соответствия требованиям NACE ISO 15156 для материалов, контактирующих с рабочей средой;                                                                                                                                           |
| TS                                                                                                                               | – этикетка металлическая из нержавеющей стали;                                                                                                                                                                                                  |
| W                                                                                                                                | – пластина маркировочная                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 Исполнение монтажной головки:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _____ - __/IP6_                                                                                                                  | – монтажная головка AL50 (MA), AL70(NA), AL70-2 (DANAW), AL85 (DA), ALZ (DAO), PZ(SEG), PD, PM, ZC, с вводом кабельным по спецификации заказа*, со степенью защиты IP65*, IP66, IP66/IP67, IP67 (определяется степенью защиты ввода кабельного) |
| 12 Оснащение монтажной головки:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WO*                                                                                                                              | – без оснащения;                                                                                                                                                                                                                                |
| KZ                                                                                                                               | – колодка зажимная KZ                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 Диапазон измерений, °C: см. таблицы 1 – 2                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 Комплекты (по спецификации заказа):                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| О__                                                                                                                              | – гильза защитная термометрическая типа О ТУ ВУ 390317133.005;                                                                                                                                                                                  |
| U__                                                                                                                              | – устройство закладное типа U ТУ ВУ 390317133.006;                                                                                                                                                                                              |
| C__                                                                                                                              | – соединение трубопроводное резьбовое типа С ТУ ВУ 390317133.004;                                                                                                                                                                               |
| PCP                                                                                                                              | – универсальное приспособление для термопреобразователей для монтажа в любом положении на конструкции или горизонтальной трубе от Ø25 до Ø31 мм;                                                                                                |
| X                                                                                                                                | – по спецификации заказа                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 Свидетельство о государственной первичной поверке – Св, протокол государственной первичной поверки – Пр по заказу потребителя |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 Кодовое обозначение государств, указывающее страну потребителя: BY, KAZ, RU, AZ, UZ и др.*                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * Допускается не обозначать                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |

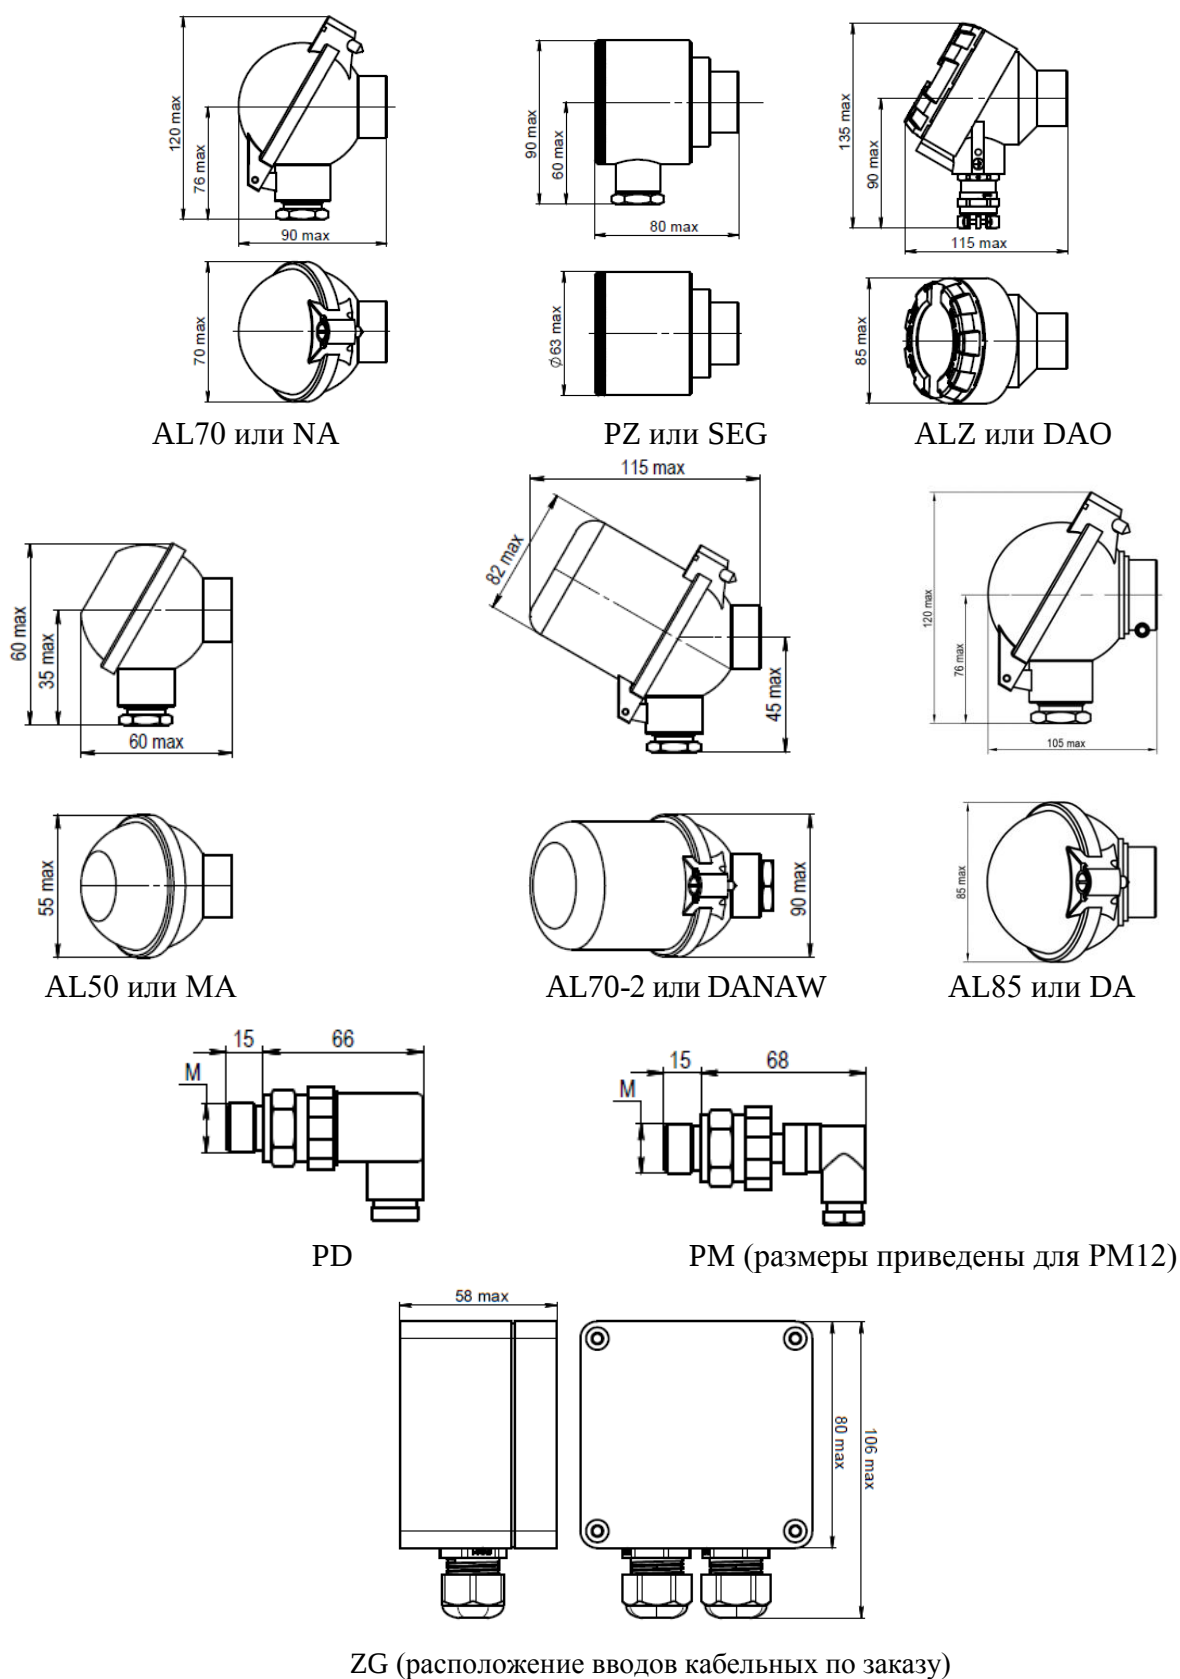

Указывается одно из обозначений монтажных головок: AL50 или MA, AL70 или NA, AL70-2 или DANAW, AL85 или DA, ALZ или DAO, PZ или SEG

Рисунок А.9 – Монтажные головки из алюминия, нержавеющей стали и полимеров

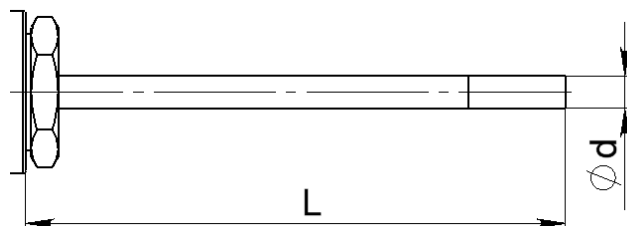


Таблица А.14

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, $\varnothing d$ , мм | Длина монтажной части, L, мм                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CTR                              | 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0                    | от 50 для диапазона измерений $\leq 200$ °C;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 600$ °C;<br>от 250 для диапазона измерений $> 600$ °C |
| CTU                              | 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 11,0        | от 50 для диапазона измерений $\leq 200$ °C;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 700$ °C;<br>от 250 для диапазона измерений $> 700$ °C |

Рисунок А.10 – Термопреобразователи модификаций CTR, CTU без вынесения монтажной головки

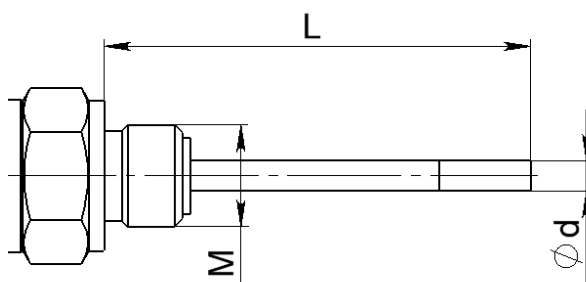


Таблица А.14

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, $\varnothing d$ , мм | Длина монтажной части, L, мм                                                                                                               | Тип монтажного присоединения, М                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CTR                              | 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0                    | от 50 для диапазона измерений $\leq 200$ °C;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 600$ °C;<br>от 250 для диапазона измерений $> 600$ °C | Резьбовое присоединение:<br>M27×2; M20×1,5; M18×1,5;<br>M12×1,5; M14×1,25; М___ (по спецификации заказа);<br>G1/2"; G1"; Г___ (по спецификации заказа);<br>1/2 NPT; 1/4 NPT; _NPT<br>(по спецификации заказа) |

Рисунок А.11 – Термопреобразователи модификации CTR без вынесения монтажной головки

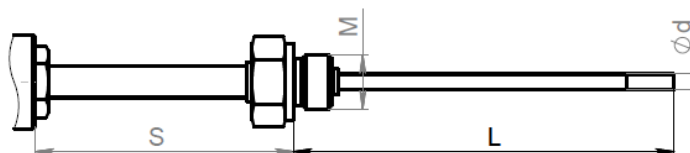


Таблица А.15

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, Ød, мм              | Вынесение монтажной головки, S, мм                      | Длина монтажной части, L, мм                                                                                                                | Тип монтажного присоединения, М                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CTR                              | 3,0; 4,0; 4,5;<br>5,0; 6,0; 8,0                | от 50 до 500 с шагом 1 мм или по спецификации заказчика | от 50 для диапазона измерений $\leq 200$ °С;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 600$ °С;<br>от 250 для диапазона измерений $> 600$ °С  | Резьбовое присоединение:<br>M27×2; M20×1,5;<br>M18×1,5; M12×1,5;<br>M14×1,25; M__ (по спецификации заказа);<br>G $\frac{1}{2}$ "; G1"; G__ (по спецификации заказа);<br>$\frac{1}{2}$ NPT; $\frac{1}{4}$ NPT; _NPT (по спецификации заказа) |
| CTU                              | 3,0; 4,0; 4,5;<br>5,0; 6,0; 8,0;<br>10,0; 11,0 |                                                         | от 100 для диапазона измерений $\leq 200$ °С;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 700$ °С;<br>от 250 для диапазона измерений $> 700$ °С |                                                                                                                                                                                                                                             |

Рисунок А.12 – Термопреобразователи модификаций CTR, CTU с вынесением монтажной головки

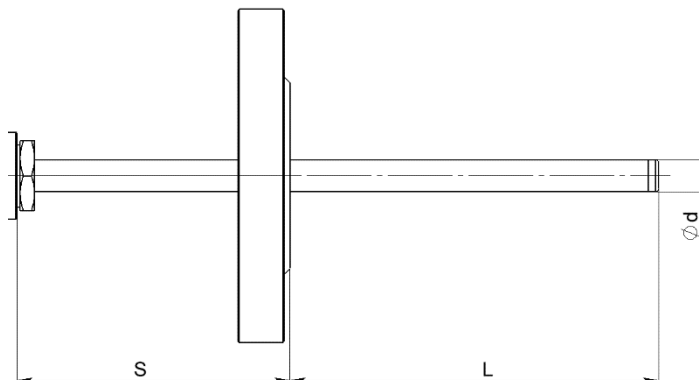


Таблица А.16

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, Ød, мм         | Вынесение монтажной головки, S, мм                      | Длина монтажной части, L, мм                                                                                                                | Тип монтажного присоединения Н                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CTR                              | 4,0; 4,5; 5,0;<br>6,0; 8,0                | от 50 до 500 с шагом 1 мм или по спецификации заказчика | от 50 для диапазона измерений $\leq 200$ °С;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 600$ °С;<br>от 250 для диапазона измерений $> 600$ °С  | Фланцевое присоединение (по спецификации заказа)<br>DN 25 PN 16; DN 25 PN 40;<br>DN 50 PN 16; DN 50 PN40;<br>Гигиеническое присоединение (по спецификации заказа):<br>Tri-Clamp 1";<br>Tri-Clamp 1,5";<br>Tri-Clamp 2";<br>DIN 25; DIN 40; DIN 50 |
| CTU                              | 4,0; 4,5; 5,0;<br>6,0; 8,0; 10,0;<br>11,0 |                                                         | от 100 для диапазона измерений $\leq 200$ °С;<br>от 200 для диапазона измерений $\leq 700$ °С;<br>от 250 для диапазона измерений $> 700$ °С |                                                                                                                                                                                                                                                   |

Рисунок А.13 – Термопреобразователи модификации CTR, CTU с вынесением монтажной головки с фланцевым присоединением

Преобразователь температуры СТ\_ - / / / / / / / / / / / / / / /  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

где:

49

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 Диапазон измерений, °С: см. таблица 2                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| 12 Комплекты (по спецификации заказа):                                                                                           |                                                                                                                                                  |
| О__                                                                                                                              | – гильза защитная термометрическая типа О ТУ ВУ 390317133.005;                                                                                   |
| U__                                                                                                                              | – устройство закладное типа U ТУ ВУ 390317133.006;                                                                                               |
| С__                                                                                                                              | – соединение трубопроводное резьбовое типа С ТУ ВУ 390317133.004;                                                                                |
| РСР                                                                                                                              | – универсальное приспособление для термопреобразователей для монтажа в любом положении на конструкции или горизонтальной трубе от Ø25 до Ø31 мм; |
| Х                                                                                                                                | – по спецификации заказа                                                                                                                         |
| 13 Свидетельство о государственной первичной поверке – Св, протокол государственной первичной поверки – Пр по заказу потребителя |                                                                                                                                                  |
| 14 Кодовое обозначение государств, указывающее страну потребителя: ВУ, KAZ, RU, AZ, UZ и др.**                                   |                                                                                                                                                  |
| * Допускается не обозначать                                                                                                      |                                                                                                                                                  |

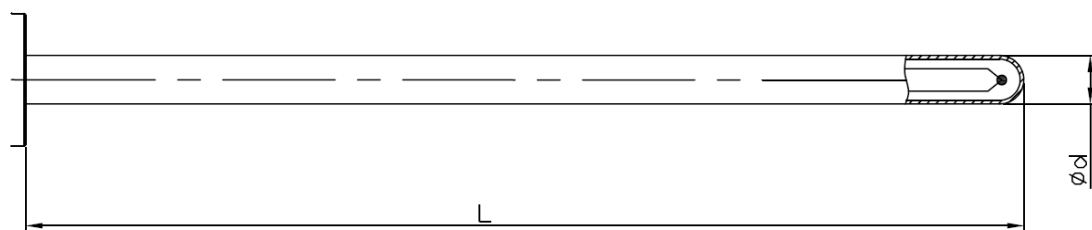


Таблица А.17

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, Ød, мм                        | Длина монтажной части, L, мм                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СТУ                              | 22,0; 24,0; 25,0; 22,0x2; 22x3,5; 26x3; 28,0; 50,0; 57,0 | 500; 520; 565; 600; 635; 700; 765; 785; 865; 910; 915; 950; 1000; 1025; 1400; 2000 или по спецификации заказа |

Рисунок А.14 – Термопреобразователи модификации СТУ конструктивного исполнения U

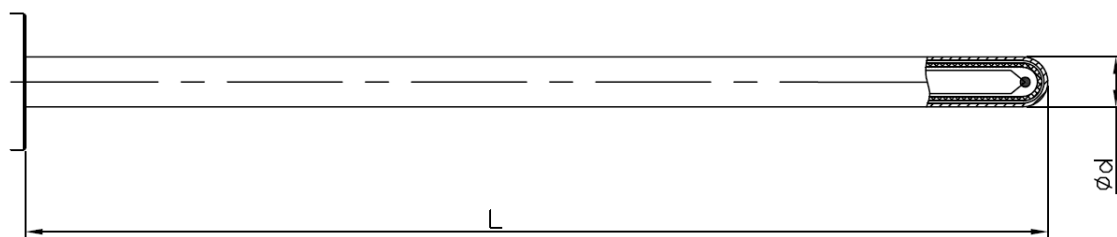


Таблица А.18

| Модификация термопреобразователя | Диаметр защитного корпуса, Ød, мм                                 | Длина монтажной части, L, мм                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| СТУ                              | 6,0; 10,0; 11,0; 14,0; 15,0; 21,3; 22,0; 24,0; 22x2; 22x3,5; 26x3 | 500; 700; 1000; 1400 или по спецификации заказа |

Рисунок А.15 – Термопреобразователи модификации СТУ конструктивного исполнения UC

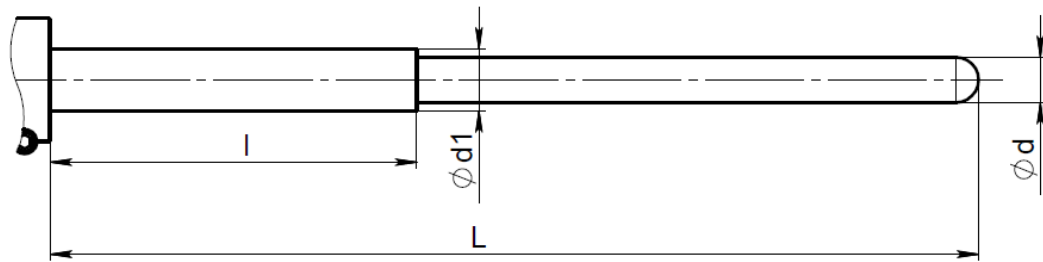


Таблица А.19

| Модификация термо-преобразователя | Диаметр защитного корпуса, $\varnothing d/\varnothing d_1$ , мм                                      | Длина монтажной части, $L/l$ , мм                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| СТУ                               | 6/10; 6/15; 8/12; 10/15; 12/15;<br>15/21,3; 15/22; 22/30; 24/30; 24/32<br>или по спецификации заказа | 450/150; 500/150; 700/150;<br>1000/150; 1400/150 или<br>по спецификации заказа |

Рисунок А.16 – Термопреобразователи модификации СТУ  
конструктивного исполнения С

А.11 Схема составления условного обозначения термопреобразователей модификации СТU конструктивного исполнения U01

Преобразователь температуры СТ \_ \_ \_ \_ \_ / \_ \_ \_ \_ \_ / \_ \_ \_ \_ \_ / \_ \_ \_ \_ \_ / \_ \_ \_ \_ \_  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ТУ ВУ 390317133.001–2014\*,

где:

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Тип применяемого первичного преобразователя                                                                                    |                                                                                                                                                  |
| U                                                                                                                                | – преобразователь термоэлектрический по ГОСТ 6616 с НСХ по СТБ ГОСТ Р 8.585 (ТП)                                                                 |
| 2 Диаметр термоэлектродного провода, мм:                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| 0,35; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 3,2                                                                                                     | – Ø0,35; 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 3,00; 3,20 (по спецификации заказа)                                                                             |
| 3 Конструктивное исполнение:                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| 4 Код защитного корпуса (изолятора): U01                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| IZ1, IZ2, IZ3, IZ4, IZ5, IZ6, IZ7                                                                                                | – см. таблицу А.20                                                                                                                               |
| 5 Длина L <sub>1</sub> =__ мм/L <sub>2</sub> =__ мм                                                                              | – длина термоэлектродного провода из ряда от 250 до 10000 мм с шагом 1,0 мм/длина изолятора, мм                                                  |
| 6 Количество (по заказу, n=1 не указывается, по умолчанию) и тип первичных преобразователей:                                     |                                                                                                                                                  |
| n×J                                                                                                                              | – ТП типа J;                                                                                                                                     |
| n×K                                                                                                                              | – ТП типа K;                                                                                                                                     |
| n×S                                                                                                                              | – ТП типа S;                                                                                                                                     |
| n×T                                                                                                                              | – ТП типа T;                                                                                                                                     |
| n×N                                                                                                                              | – ТП типа N;                                                                                                                                     |
| n×L                                                                                                                              | – ТП типа L                                                                                                                                      |
| 7 Класс допуска: 1, 2, 3                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| 8 Специальное исполнение:                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
| Ex                                                                                                                               | – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»;                                                         |
| TS                                                                                                                               | – этикетка металлическая из нержавеющей стали;                                                                                                   |
| W                                                                                                                                | – пластина маркировочная                                                                                                                         |
| 9 Диапазон измерений, °C: см. таблица 2                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| 10 Комплекты (по спецификации заказа):                                                                                           |                                                                                                                                                  |
| KZ                                                                                                                               | – колодка зажимная KZ;                                                                                                                           |
| O                                                                                                                                | – гильза защитная термометрическая типа О ТУ ВУ 390317133.005;                                                                                   |
| U                                                                                                                                | – устройство закладное типа U ТУ ВУ 390317133.006;                                                                                               |
| C                                                                                                                                | – соединение трубопроводное резьбовое типа С ТУ ВУ 390317133.004;                                                                                |
| PCP                                                                                                                              | – универсальное приспособление для термопреобразователей для монтажа в любом положении на конструкции или горизонтальной трубе от Ø25 до Ø31 мм; |
| X                                                                                                                                | – по спецификации заказа                                                                                                                         |
| 11 Свидетельство о государственной первичной поверке – Св, протокол государственной первичной поверки – Пр по заказу потребителя |                                                                                                                                                  |
| 12 Кодовое обозначение государств, указывающее страну потребителя: ВУ, KAZ, RU, AZ, UZ и др.*                                    |                                                                                                                                                  |
| * Допускается не обозначать                                                                                                      |                                                                                                                                                  |

Таблица А.20

| Код изолятора     | Размеры изолятора, мм                               | Количество отверстий, шт. | Диаметр отверстий, $\varnothing d$ , мм | Код материал изолятора |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| IZ1               | 4x8x12x100 <sup>1)</sup>                            | 2                         | 4,0                                     | 610                    |
| IZ2               | $\varnothing 14 \times 3,5 \times 50$ <sup>2)</sup> | 4                         | 3,5                                     | 610                    |
| IZ3 <sup>3)</sup> | $\varnothing 3,0 \times 0,8 \times L$ <sup>4)</sup> | 4                         | 0,8                                     | 799                    |
| IZ4 <sup>3)</sup> | $\varnothing 4,0 \times 0,8 \times L$ <sup>4)</sup> | 4                         | 0,8                                     | 799                    |
| IZ5 <sup>3)</sup> | $\varnothing 5,5 \times 1,2 \times L$ <sup>4)</sup> | 4                         | 1,2                                     | 799                    |
| IZ6 <sup>3)</sup> | $\varnothing 8,0 \times 1,5 \times L$ <sup>4)</sup> | 4                         | 1,5                                     | 799                    |
| IZ7 <sup>3)</sup> | $\varnothing 8,5 \times 2,0 \times L$ <sup>4)</sup> | 4                         | 2,0                                     | 799                    |

<sup>1)</sup> Изолятор овального сечения и длиной 100 мм (для более длинных вставок кратно 100 мм);

<sup>2)</sup> L – длина по заказу;

<sup>3)</sup> Допускается использовать для одиночных ТП;

<sup>4)</sup> Изолятор круглого сечения длиной 50 мм (для более длинных вставок кратно 50 мм)

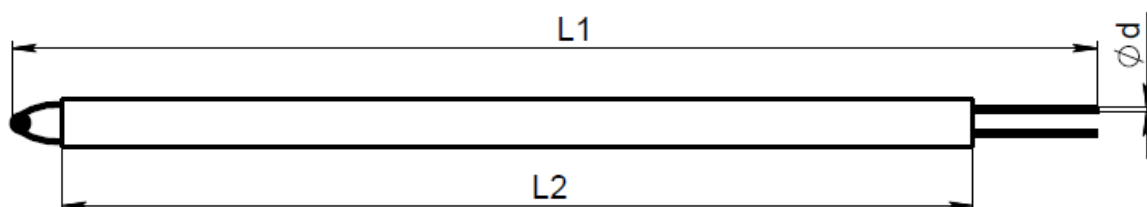


Рисунок А.17 – Термопреобразователи модификации СТU конструктивного исполнения U01







**ПРОИЗВОДСТВО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  
ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ  
И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ**

Республика Беларусь, 210516,  
г. Витебск, ул. М. Горького, д. 42А, каб. 7

Тел/факс: +375 212 36-36-98,  
моб.: +375 44 552-30-90  
[www.aplisens.by](http://www.aplisens.by) | [info@aplisens.by](mailto:info@aplisens.by)

